



电话: (86) 20-32293871  
 传真: (86) 20-32293700  
 网址: www.cvc.org.cn  
 报告编号.: YHB2018-0021

## 政府采购项目抽检报告



第三评审方: 威凯认证检测有限公司 (威凯检测技术有限公司)

抽检委托单位: 深圳市政府采购中心

采购单位: 深圳孙逸仙心血管医院

履约供应商: 深圳市同创博大商贸有限公司

项目编号	SZCG2017158012	抽检日期	2018.02.01
抽检地点	孙逸仙心血管医院	抽检时间	10:00-16:30
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: <u>GB/T 2828.1-2012</u> ) <input type="checkbox"/> 其他		

产品名称	合同编号	产品型号/规格	总数量	抽样抽检数量
高速双面多功能一体机	SZHT (2017) 021126	MFC-8540DN	155	13台

满分: 100分  
 实际得分: 80分  
 抽检结论: 良

主检: 张治文、张仲正

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:

签名:

签名:

日期: 2018年02月01日

日期: 2018年02月02日

日期: 2018年02月05日



## 抽检结果摘要

抽检依据: 双方签订的合同(合同编号: SZHT(2017)021126、项目编号: SZCG2017158012; 项目名称: 深圳市孙逸仙心血管医院-高速双面多功能一体机)。

抽样依据标准: 依照抽样标准 GB/T 2828.1-2012

抽检项目及抽样依照客户要求, 详见下表

### 商务要求

序号	检查项目	商务要求	检验方法/依据	描述
1	交货要求	1. 合同签订后 7 个日历日内, 乙方负责将设备在深圳指定地安装调试, 由甲方负责验收。	依据双方合同上的货物交付要求, 条款判断。	部分设备未拆封, 未进行安装调试
2	售后服务	<p>(1) 1. 免费保修期: 货物整机免费保修期三年, 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。保修期内, 中标方负责对货物进行上门硬件维修、软件免费维护服务。</p> <p>(2) 维修响应及故障解决时间: 在保修期内, 一旦发生质量问题, 投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。</p> <p>(3) 其他: 投标人应按其投标文件中的承诺, 进行其他售后服务工作。</p> <p>(4) 质保期内, 保证每年至少 1 次以上免费集中定期维护保养。</p> <p>(5) 免费质保期满后, 质保期外的维修只以成本价收取零配件费。</p>	依据双方合同售后服务条款进行判断。	<p>条款要求保修期为“货物整机免费保修三年, 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。”</p> <p>与实际原厂保修条款中描述“自购机之日起(以正式</p>


序号	检查项目	商务要求	检验方法/依据	描述
				购货发票为准) 三年或总打印张数达到规定量任一条件先到为准”不符。

缺陷描述:





缺陷描述: 部分设备未拆封, 未进行安装调试

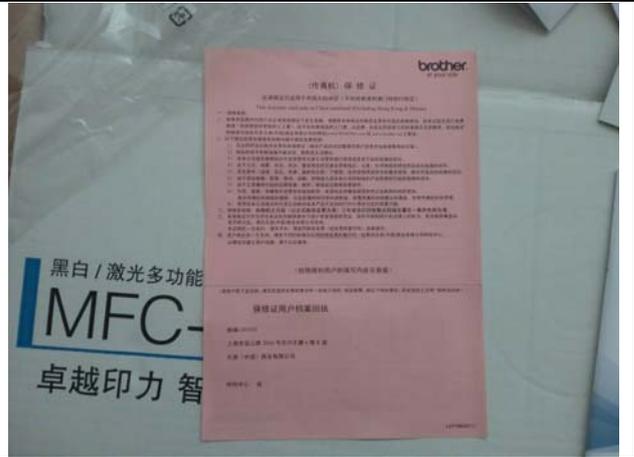



电话: (86) 20-32293871  
 传真: (86) 20-32293700  
 网址: www.cvc.org.cn  
 报告编号.: YHB2018-0021

由于正常使用引起的定期位置、维护、维修或定期更换零件。  
 8) 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件以及耗用材料的更换。  
 激光传真机的硒鼓和墨粉, 以及彩激的转印带和废粉盒, 喷墨传真机的喷头和墨盒, 色带传真机的色带等。  
 9) 使用非本公司指定的兄弟正品耗材或本产品不支持的打印介质所引起的问题。  
**保修有效期: 自购机之日起 (以正式购货发票为准) 三年或总打印张数达到规定量任一条件先到为准。**  
 本保修证只作为符合本证所列期限条件下用户享受保修的凭证, 因而不限制用户在法律上的权力。有关维修事宜如有不明之处, 请向兄弟(中国)商业有限公司咨询。  
 本证随机一次发行, 遗失不补, 请连同购货发票 (或发票的复印件) 妥善保存。  
 用户购买后一个月内, 请把下列回执填写后同购物发票的复印件一起寄回兄弟(中国)商业有限公司呼叫中心, 以便给您建立用户档案, 便于以后查询。

缺陷描述: 条款要求保修期为“货物整机免费保修三年, 时间自终验收合格并交付使用之日起计算。”与实际原厂保修条款中描述“自购机之日起 (以正式购货发票为准) 三年或总打印张数达到规定量任一条件先到为准”不符。

### 技术要求一

序号	货物名称	订单数量	抽检数量	项目等级	规格型号/品牌/原产地/技术参数	检查方法/依据	描述
3	高速双面多功能一体机	155台	13	B	品牌: 兄弟 型号: MFC-8540DN <b>技术参数:</b> (1) 涵盖功能: 打印, 复印, 扫描, 传真 (2) 内存: 512MB (3) 最大处理幅面: A4 (4) A4 黑白打印速度: 40ppm (5) 分辨率: 1200*1200dpi (6) 双面打印: 自动 (7) 双面复印: 自动 (8) 双面扫描: 自动 (9) 双面传真: 自动 (10) 连续复印: 99 页 (11) 扫描类型: 平板+馈纸 (12) 有线网络打印: 标配 (13) 耗材类型: 鼓粉分离 (14) 其他功能: U 盘打印、NFC 打印、U 盘扫描、彩色液晶屏显示 (15) 扫描到: 图像, 文件, OCR, FTP, PDF	按照说明书操作, 查看铭牌、合格证、测试报告等资料	符合要求



电话: (86) 20-32293871  
传真: (86) 20-32293700  
网址: www.cvc.org.cn  
报告编号.: YHB2018-0021

序号	货物名称	订单数量	抽检数量	项目等级	规格型号/品牌/原产地/ 技术参数	检查方法/ 依据	描述
					(16) 赠送原厂正式版管理软件 提供原厂 SDK 开发包		

## 技术要求二

序号	检查项目	项目等级	检验方法/依据	描述
6	功能使用检查	B	该打印机可以满足正常使用要求 (依照说明书)	符合要求
7	外观检查	C	无外观缺陷(如乱花、破损、污渍、油漆不良、外观变形、丝印不良, 标签铭牌等粘贴不良等)	符合要求



电话: (86) 20-32293871  
 传真: (86) 20-32293700  
 网址: www.cvc.org.cn  
 报告编号.: YHB2018-0021

## 附件 1 抽检现场照片

### 高速双面多功能一体机



合同



送货单





N/A



高速双面多功能一体机外箱



高速双面多功能一体机开箱状态



电话: (86) 20-32293871  
 传真: (86) 20-32293700  
 网址: www.cvc.org.cn  
 报告编号: YHB2018-0021

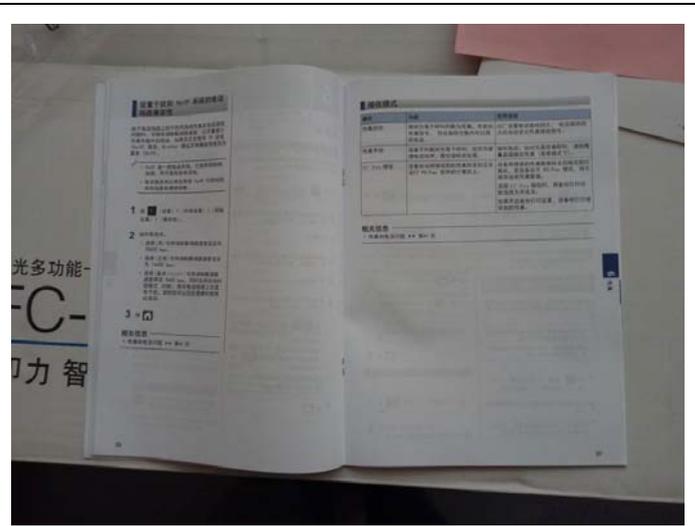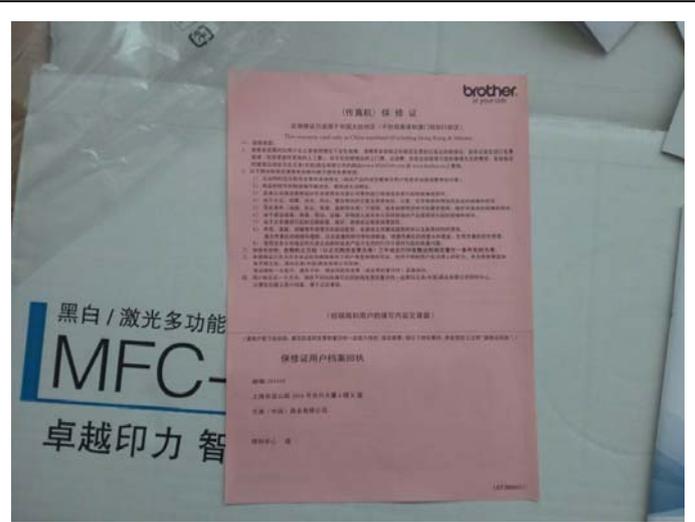

保修卡及说明书



N/A

电源插头



高速双面多功能一体机



电话: (86) 20-32293871  
传真: (86) 20-32293700  
网址: www.cvc.org.cn  
报告编号.: YHB2018-0021

---

# Declaration

## 声 明

The inspection result is responsible for the inspected batch of products only.

检验结果只对本次检验批次负责。

Any photocopies or part photocopies of the inspection report are forbidden without permission from CVC and Applicant.

未经许可本报告不得复制。

The inspection report is invalid if altered.

报告涂改无效。

Vkan Certification & Testing Co., Ltd (CVC)

威凯认证检测有限公司（威凯检测技术有限公司）

**Address:** No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, ScienceCity, Guangzhou, 510663, P. R. China

**地址:** 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路3号

**Postal Code 邮政编码:** 510663

**TEL 电话:** 020 32293888

**FAX 传真:** 020 32293889

**E-mail 电子邮件:** office@cvc.org.cn