

深圳华通威国际检验有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030118

项目名称: 清华大学深圳研究生院服务器竞价采购

项目编号: SZCG2016123449

采购单位: 清华大学深圳研究生院

供应商: 东莞超博电子科技有限公司

委托机构: 深圳市政府采购中心

检验机构: 深圳华通威国际检验有限公司

<p>主检: 邱耀光 审核: 杜登廷 签发: 江子 签发日期: 2017年03月17日</p>	
---	--

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030118

第 1 页 共 4 页

项目名称	清华大学深圳研究生院服务器竞价采购		
项目编号	SZCG2016123449	合同编号	SZHT (2016) 016281
采购单位	清华大学深圳研究生院		
履约供应商	东莞超博电子科技有限公司		
第三评审方	深圳华通威国际检验有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	海洋大楼 F104		
现场抽检日期	2017-03-07	环境条件	25℃
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 标准 (标准号: _____) <input type="checkbox"/> 其它 _____		
现场抽检 结果汇总	<p>本次现场抽检项目与招标文件、合同要求一致:</p> <p style="text-align: center;">根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 100 分, 抽检结果评价等级为优。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">检验机构代表签字: </p>		

通威
检验

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030118

第 2 页共 4 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	合同签订后的 14 个日历日内完成设备的交付。	符合要求	符合
2	售后服务	保修期: 制造商整机三 年保修。	符合要求	符合


(2) 招标文件技术规格要求

序号	检查项目	技术要求	结果	评价
1	服务器	品牌型号: AMAX XG-44301	符合要求	符合
		数量: 1 台	符合要求	符合
		处理器: 4 颗 E7-8890v3 (每颗 2.5GHz, 18 核)	符合要求	符合
		内存: 256G (16G*16)DDR3 ECC Re gistered 共享内存, 具有错误校验功能, 包含寄存器单元, 提升平台计算精确性和系统稳定性	符合要求	符合
		硬盘: 2*4TB 7200RPM 64MB 6Gb/s SATA	符合要求	符合
		网卡: infinband 56GB IB 单口网卡, 集成 双千兆网口	符合要求	符合
		机箱: 4U 机架式机箱	符合要求	符合
		内嵌支持 NVIDIA CUDA 5.5 ACM1.6 平台正版 管理软件;	符合要求	符合
		产品厂商应为 NVIDIA Tesla Preferred Provider 、NVIDIA Tesla Bio Workbench 成员;	符合要求	符合
		安装 OpenMPI、intel®Math Kernel Library, BLAS, LAPACK, FFTW、CUDA 驱动, CUDA 工具包, CUDA SDK;	符合要求	符合
		3 年整机产品质保, 产品具备远程机器检测能力;	符合要求	符合
其他要求: 提供软硬件和相应服务完成各服务器的联网并行运算。	符合要求	符合		

示检
专用
一

附录: 检测图片

照片 1:
服务器主机

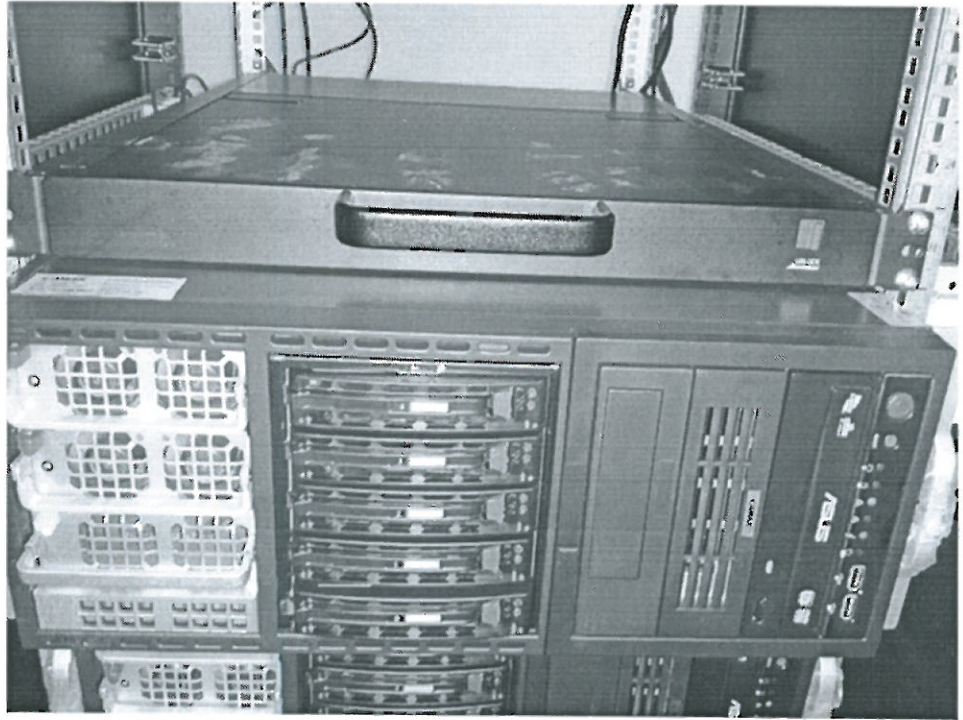

照片 2:
硬盘




有
章

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030118

第 4 页共 4 页

照片 3:
软件

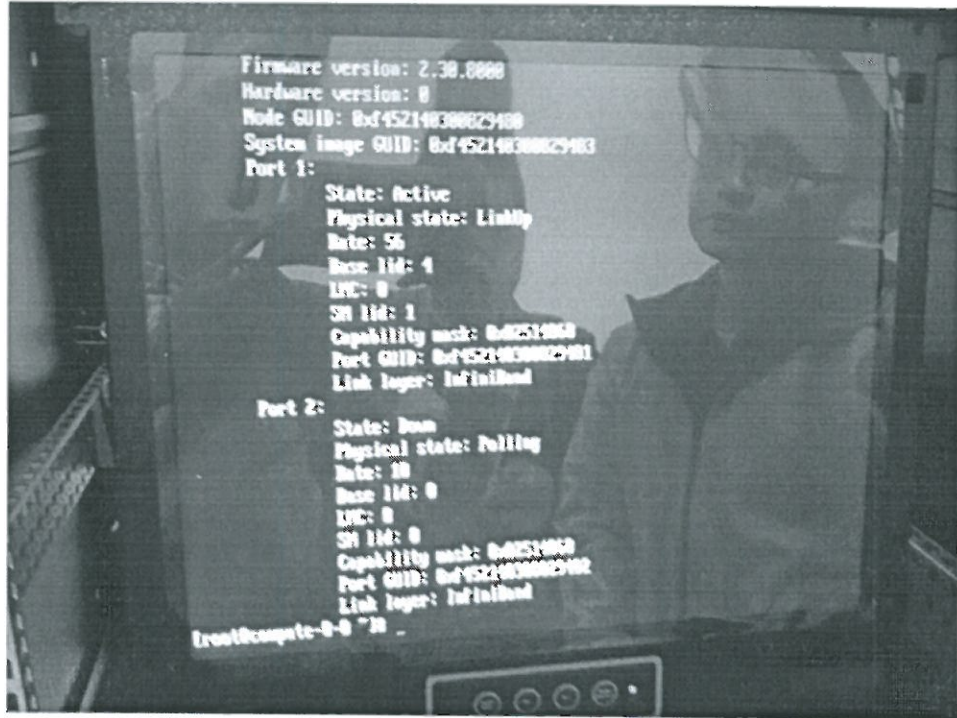

照片 4:
主机铭牌

