

深圳华通威国际检验有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号：ZFCJ17030119

项目名称：北京大学深圳医院笔记本电脑竞价采购

项目编号：SZCG2016134344

采购单位：北京大学深圳医院

供应商：深圳市长城网信息科技股份有限公司

委托机构：深圳市政府采购中心

检验机构：深圳华通威国际检验有限公司

主检：邓辉龙

审核：杜程院

签发：江子

签发日期：2017年03月17日



政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030119

第 1 页 共 6 页

项目名称	北京大学深圳医院笔记本电脑竞价采购		
项目编号	SZCG2016134344	合同编号	SZHT (2016) 016447
采购单位	北京大学深圳医院		
履约供应商	深圳市长城网信息科技股份有限公司		
第三评审方	深圳华通威国际检验有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	北京大学深圳医院 501 信息中心办公室		
现场抽检日期	2017-03-15	环境条件	25℃
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 标准 (标准号: _____) <input type="checkbox"/> 其它 _____		
现场抽检结果汇总	<p>经确认, 该项目已通过甲方验收。 本次现场抽检 5 台, 发现以下项目与招标文件要求不一致: (1) 定制服务: 开机画面未显示“北京大学深圳医院” logo 的程序, 与招标文件要求开机画面显示“北京大学深圳医院” logo 的程序条款不符。</p> <p style="text-align: center;">根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 97 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p style="text-align: center;">具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">检验机构代表签字: </p>		

(抄 送)

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030119

第 2 页共 6 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	合同签订后的5个日历日内完成设备的交付。	符合要求	符合
2	售后服务	保修期: 整机原厂三年上门保修。	符合要求	符合

(2) 招标文件技术规格要求

序号	检查项目	技术要求	结果	评价
1	笔记本电脑	品牌型号: 联想 ThinkPad L460	符合要求	符合
		电池: 6 芯锂 (72Wh)	符合要求	符合
		数量: 85	符合要求	符合
		处理器 CPU: Intel i7-6500U (2.5GHz, 4M)	符合要求	符合
		内存: 8G DDR4 1600MHz	符合要求	符合
		硬盘: 1TB 7200rpm SATA 硬盘, 128G 固态硬盘	符合要求	符合
		显示屏: 14" HD LED 背光显示屏, 分辨率 1366x768	符合要求	符合
		显卡: 2G 独立显卡网卡	符合要求	符合
		网卡: 千兆网卡以及 802.11ac 无线网卡, 配置原厂网络连接软件, 包括有线和无线连接辅助, 能够导入导出网络配置, 支持 3G 网络	符合要求	符合
		摄像头: 720P 高清摄像头	符合要求	符合
		蓝牙: 蓝牙设备	符合要求	符合
		定位设备: 3+2 经典触摸板 + 指点杆	符合要求	符合
		端口: 3*USB 3.0 接口 (1 个 PowerUSB), Mini DisplayPort, VGA 接口, RJ45, 麦克风&耳机组合接口, 线缆锁孔, 4 合 1 读卡器, 智能读卡器	符合要求	符合
		操作系统: Windows 7 家庭基础版 64 位操作系统	符合要求	符合
		安全特性: 配置主动硬盘保护系统, 自动感应笔记本运动状态, 预防因意外震荡对硬盘造成损伤; 系统安全 原厂同品牌一键恢复操作系统 (非 Windows 自带功能), 可保留出厂备份和用户自定义备份	符合要求	符合
定制服务: 出厂定制开机画面显示“北京大学深圳医院” logo 的程序	开机画面未显示“北京大学深圳医院” logo 的程序	不符合		

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030119

第 3 页 共 6 页

	<p>整机认证: 通过 EPEAT Gold 认证, 3C 认证;</p>	符合要求	符合
	<p>其他要求: 所有配置必须在厂商预装出厂, 竞价供应商不得私自改装非原厂配件交货, 所投机型必须在制造商官网上直接可以查询, 非公开发售的特供机、专用机、组装机等不得参与投标; 保证完整包装不开封并出厂注明采购单位名称, 所有出厂配置在制造商官网上可根据机器序列号编码查询, 保修服务期限可查询。出厂时标签带有: SN+MAC1+MAC2 的信息;</p>	符合要求	符合
	<p>体积: 重量\leq2.02Kg, 厚度\leq24.3mm</p>	符合要求	符合

国际
 检
 一


政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030119


第 4 页 共 6 页

附录: 检测图片

照片 1:
主机与电源

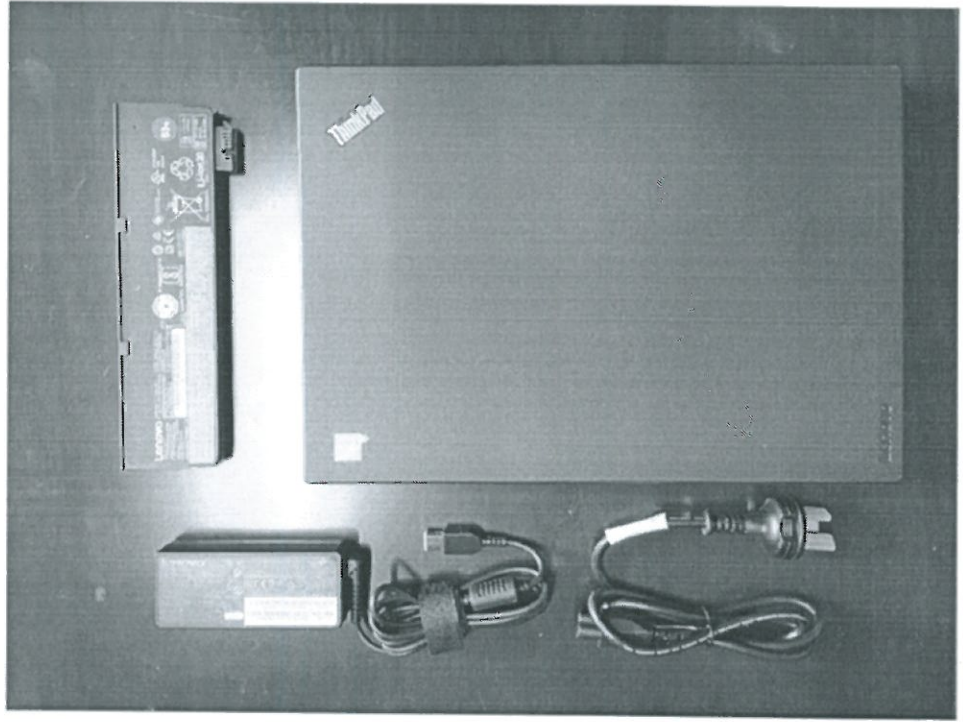

照片 2:
主机正面

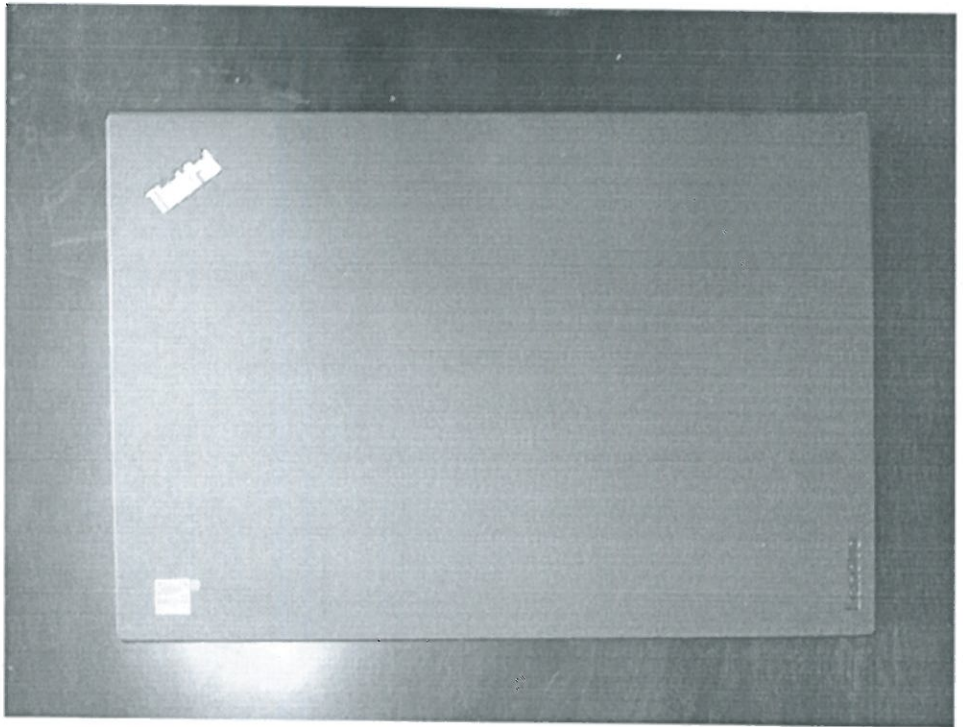


政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17030119

第 5 页 共 6 页

照片 3:
主机背面

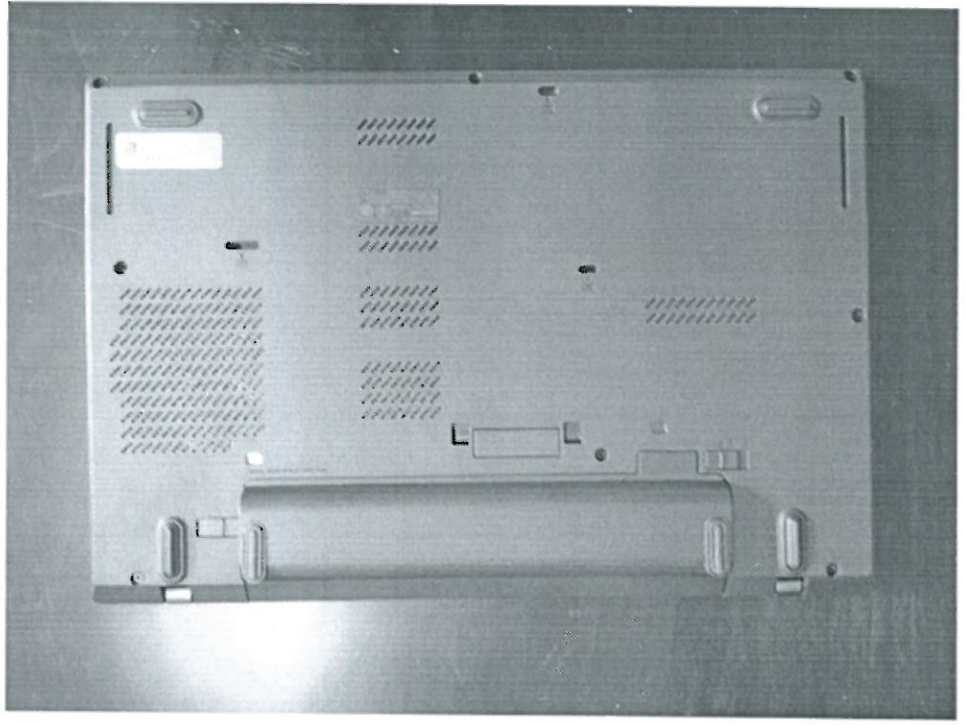

照片 4:
侧面端口

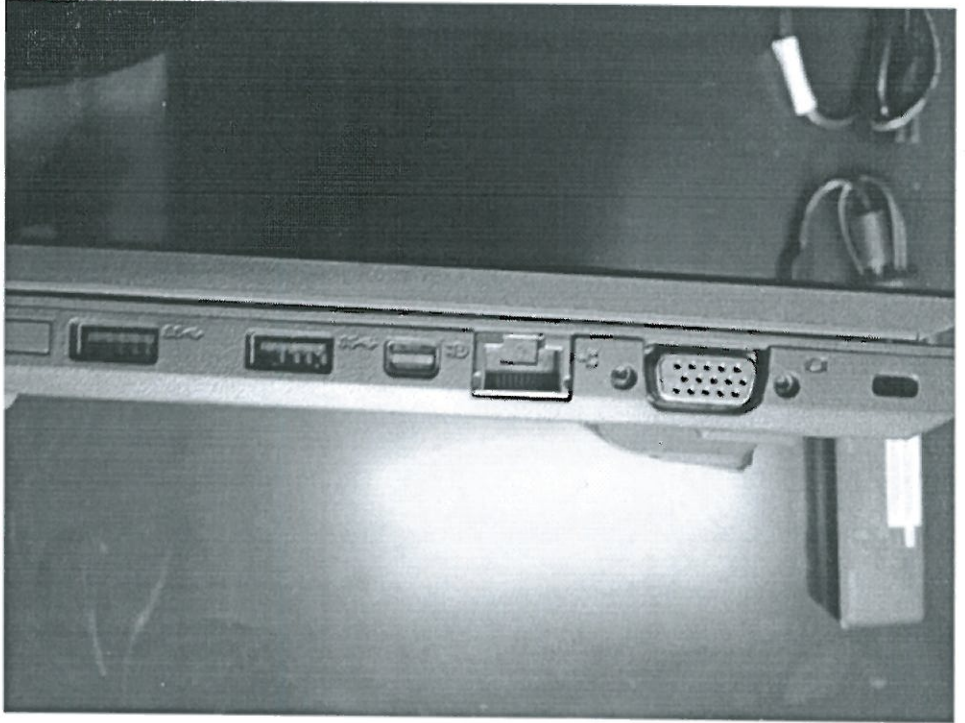


有限公司
章

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17030119

第 6 页共 6 页

照片 5:
侧面端口

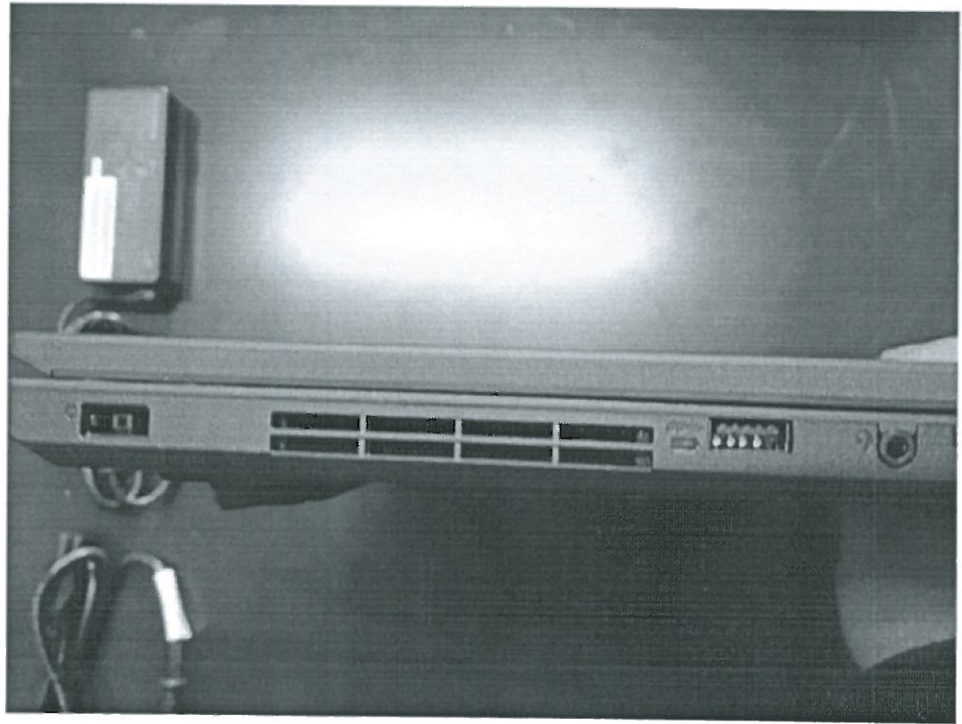

照片 6:
外包装



15