

深圳华通威国际检验有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17060181

项目名称: 深圳大学西丽校区一期开办费购台式计算机竞价
采购


项目编号: SZCG2017143356

采购单位: 深圳大学

供应商: 深圳市耀蓝科技有限公司

委托机构: 深圳市政府采购中心

检验机构: 深圳华通威国际检验有限公司

<p>主检: 邱辉宏 审核: 杜强臣 签发: 江乃 签发日期: 2017 年 06 月 20 日</p>	
--	--

政府采购项目抽检报告

报告编号：ZFCJ17050162

第 1 页共 4 页

项目名称	深圳大学西丽校区一期开办费购台式计算机竞价采购		
项目编号	SZCG2017143356	合同编号	SZHT (2017) 017530
采购单位	深圳大学		
履约供应商	深圳市耀蓝科技有限公司		
第三评审方	深圳华通威国际检验有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳大学（服务大厅、仓库）		
现场抽检日期	2017-06-08	环境条件	25℃
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件（采购需求） <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 标准（标准号： ） <input type="checkbox"/> 其它		
抽检结果汇总	<p style="text-align: center;">本次现场抽检发现以下问题与招标文件、合同要求不一致： 现场检测交货时间：“送货日期：2017-03-15”，与招标文件、合同“合同签订后的 7 个日历日内完成设备的交货（合同签订日期：2017-02-23）”条款不符；</p> <p style="text-align: center;">根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 90 分，抽检结果评价等级为良。</p> <p style="text-align: center;">具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 检验机构代表签字： </div>		



政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17050162

第 2 页共 4 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	合同签订后的7个日历日内完成设备的交付。	送货日期: 2017-03-15 合同签订日期: 2017-02-23	不符合
2	售后服务	质保期 5 年, 质保期内, 如果有因质量问题而引起的损坏, 供应商应对产品予以维修或更换, 全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担。	符合要求	符合

(2) 招标文件技术规格要求

序号	检查项目	技术要求	结果	评价
1	台式计算机	品牌型号: 联想 M4600-N000	符合要求	符合
		电源: ≥110/220V 300W 节能电源	符合要求	符合
		数量: 222	符合要求	符合
		CPU: ≥Intel Core i7-6700 3.4G 4C	符合要求	符合
		内存: ≥8G DDR4 2133MHz 内存;	符合要求	符合
		硬盘: ≥1T SATA+128G SSD;	符合要求	符合
		显示器: 21.5 寸 WLED 显示器, 分辨率 1920x1080, 屏幕比例 16:10, 亮度不低于 250, 对比度不低于 1000:1, 响应时间 ≤5ms, VGA+DVI 接口;	符合要求	符合
		显卡: 集成显卡;	符合要求	符合
		网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡, 支持光纤网卡。	符合要求	符合
		光驱: DVD-RW。	符合要求	符合
		声卡: 集成 HD Audio, 支持 5.1 声道。	符合要求	符合
		扩展槽: ≥1 个 PCI-E*16, ≥2 个 PCI-E*1。	符合要求	符合
		端口: ≥6 个 USB 接口 (前置 2 个 USB 3.0 接口分离放置)、PS/2 接口、串口, VGA+HDMI 接口, 支持双屏显示, 可选多合一读卡器。	符合要求	符合
		键盘/鼠标: 防水抗菌键盘、USB 抗菌鼠标。	符合要求	符合
		随机应用: 电脑配置开机画面显示“深圳大学” logo 的程序; 安全管理: 能够实现 USB 端口的有效管理、能够配置网络带宽; 可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级; 能够对软/硬件资产进行统计, 监控软/硬件变更, 并可报警; 能够提供完善的报表和系统日志。	符合要求	符合
机箱: 标准 MATX 立式机箱, 不大于 20L, 配后 10 安全盖板或同样功能 (保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔); 配置机箱报警开关: 防止机箱被打开; 自带电池, 主机断电也可发出声音。	符合要求	符合		

威国际
实验专

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17050162


第 3 页共 4 页

附录: 检测图片

照片 1:
主机



照片 2:
主机标签

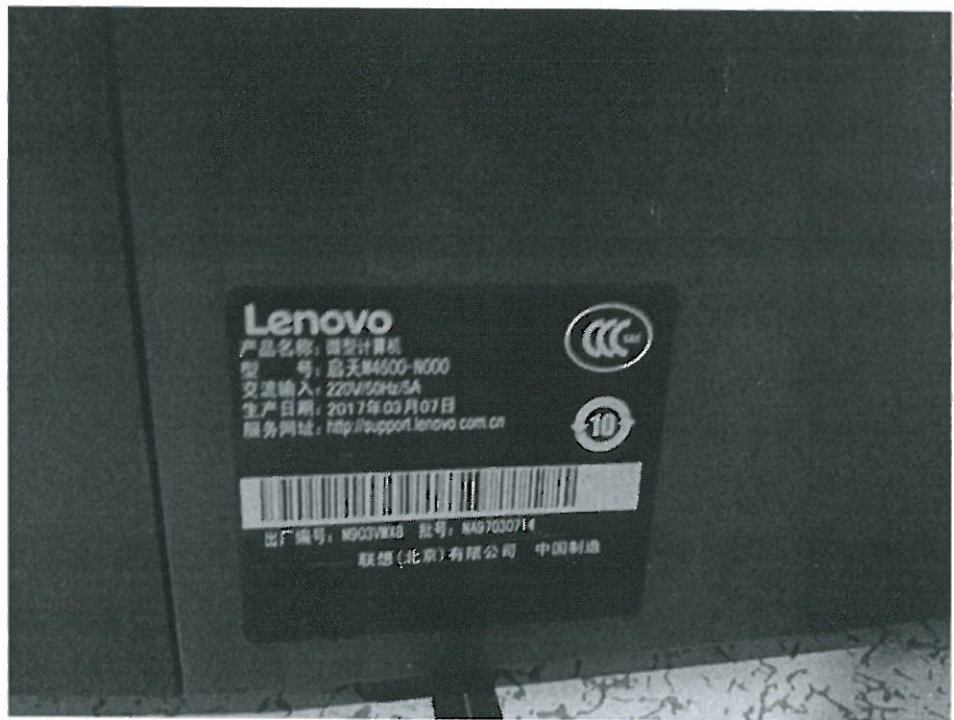


检验有
用章

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17050162

第 4 页共 4 页

照片 3:
主机内部

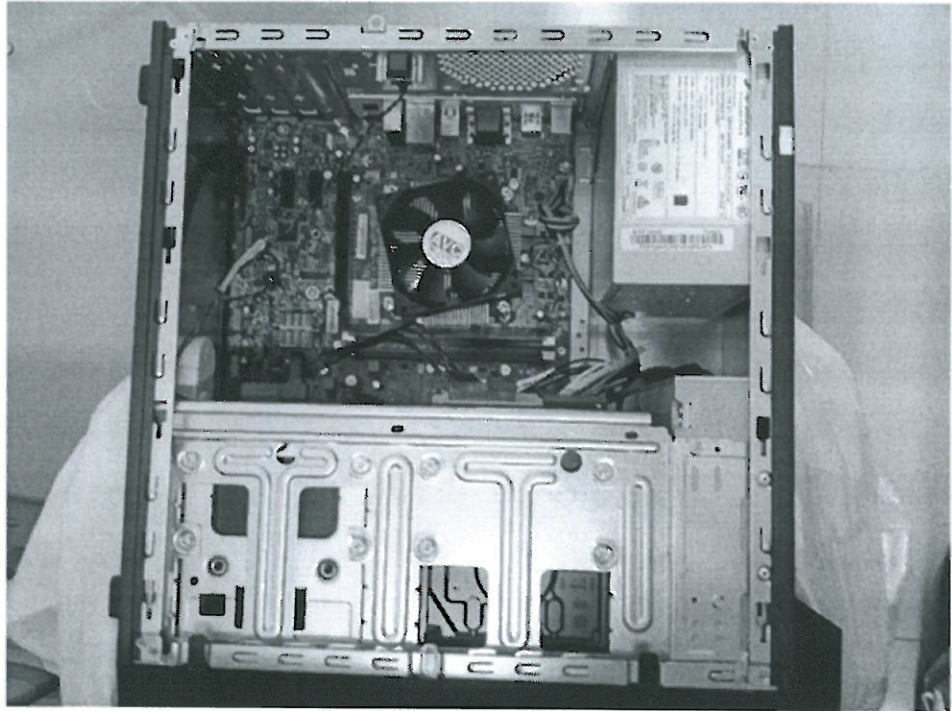

照片 4:
显示器

