

深圳华通威国际检验有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

项目名称: 深圳市孙逸仙心血管医院医疗被服用品一批采购项目





项目编号: SZCG2017153955

采购单位: 深圳市孙逸仙心血管医院

供应商: 坚业科技(深圳)有限公司

委托机构: 深圳市政府采购中心

检验机构: 深圳华通威国际检验有限公司

<p>主检: </p> <p>审核: </p> <p>签发: </p> <p>签发日期: 2017年09月18日</p>	
---	--

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 1 页共 17 页

项目名称	深圳市孙逸仙心血管医院医疗被服用品一批采购项目		
项目编号	SZCG2017153955	合同编号	SZHT (2017) 018730
采购单位	深圳市孙逸仙心血管医院		
履约供应商	坚业科技(深圳)有限公司		
第三评审方	深圳华通威国际检验有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	住院部 9 楼 0922 房		
现场抽检日期	2017-09-06	环境条件	25℃
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件(采购需求) <input checked="" type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准(标准号: <u>见下抽检单</u>) <input type="checkbox"/> 其它_____		
现场抽检 结果汇总	<p>(1)现场检测结果(占比权重 75 分):</p> <p>本次现场抽检 15 个品种发现以下问题与招标文件、合同要求不一致:</p> <p>1、现场检测规格、数量:交付的品种及数量“护士服+实习生护士服(女夏)(230 件)、护士服+实习生护士服(男夏)(30 套)、护士帽(110 件)、护士头花(300 个)、白裤子(230 件)、女护士鞋(115 对)、男护士鞋(20 对)、医院服(夏)(120 件)、成人病人服(涤棉)(120 套)、电子标签(1000 个)”,与合同要求“合同附件:投标分项报价表”条款不符;</p> <p>2、现场检测护士毛衣外衣“未植入 RFID 电子标签”与招标文件要求“须植入 RFID 电子标签”条款不符;</p> <p>3、物联管理(被服)智能信息化已送货,未安装机器,功能未体现。</p> <p>4、专用鞋智能信息化已送货,未安装机器,功能未体现。</p> <p>根据现场抽检评价,结合本项目抽检方案,现场抽检评价得分为 <u>51</u> 分。</p> <p>(2)实验室抽样检测结果(占比权重 25 分):</p> <p>1、实验室检测成人病人服(涤棉)纱线线密度(纱支):“22S*22S”与招标文件要求“32s*32s(±3%)”条款不符;</p> <p>2、实验室检测护士毛线外衣(70 毛)面料成分:“聚酯纤维:73.0%,腈纶:14.5%,羊毛:12.5%”与招标文件要求“15%棉,15%聚氨酯纤维,70%毛(±3%)”条款不符;</p> <p>结合抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽检和检测,最终检测数据和结果见检测报告。</p> <p>根据实验室抽检评价,结合本项目抽检方案,实验室抽检评价得分为 <u>15</u> 分。</p> <p>(3)项目履约抽检评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分为最终得分,并依此作相应等级评价。</p>		

政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17090099

第 2 页共 17 页

根据现场与实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 66 分, 抽检结果评价等级为 中。

具体检测数据详见政府采购项目抽检单。

检验机构代表签字:



政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 3 页共 17 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	履约供应商在接到送货通知当日起 30 天(日历日)内完成交货。	符合要求	符合
2	规格、数量	见合同中“投标分项报价表”	交付的品种及数量: 护士服+实习生护士服(女夏)(230件); 护士服+实习生护士服(男夏)(30套); 护士帽(110件); 护士头花(300个); 白裤子(230件); 女护士鞋(115对); 男护士鞋(20对); 医院服(夏)(120件); 成人病人服(涤棉)(120套); 电子标签(1000个)。	不符合
3	文件及资质	随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准,必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。	符合要求	符合

(2) 技术规格要求

法规要求(实验室抽检)					
一、医生服(夏装)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量(mg/kg)	GB/T2912.1-2009	GB18401-2010 B类产品要求(75 mg/kg)	未检出	符合
2	PH值	GB/T7573-2009	GB18401-2010 B类产品要求(4.5-8.5)	6.1	符合
3	可分解芳香胺染料	GB/T17592-2011	禁用(限量值≤20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB18401	无	无异味	符合
5	耐洗色牢度 耐摩擦色牢度	GB/T3921-2008 GB/T3920-2008	招标要求: 耐洗色牢度≥4级 耐摩擦色牢度≥4级	4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007 GB/T2910.11-2009	招标要求: 精梳35%棉 65%涤(±3%)	聚酯纤维: 64.5% 棉: 35.5%	符合
7	纱线线密度(纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 25*22.6(±3%)	24.3S*22S	符合
二、护士服+实习生护士服(女冬)					

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 4 页共 17 页

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	GB18401-2010 B 类产品要求(75 mg/kg)	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	GB18401-2010 B 类产品要求(4.5-8.5)	4.9	符合
3	可分解芳香胺染料	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 \leq 20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无	无异味	符合
5	耐洗色牢度 耐摩擦色牢度	GB/T3921-2008 GB/T3920-2008	招标要求: 耐洗色牢度 \geq 4 级 耐摩擦色牢度 \geq 4 级	4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007 GB/T2910.11-2009	招标要求: 精梳 35% 棉 65%涤 (\pm 3%)	聚酯纤维: 64.5% 棉: 35.5%	符合
7	纱线线密度 (纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 45S/2*23S (\pm 3%)	(44.6S/2)*22.4S	符合

三、成人病人服 (涤棉)

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	GB18401-2010 B 类产品要求(75 mg/kg)	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	GB18401-2010 B 类产品要求(4.5-8.5)	5.4	符合
3	可分解芳香胺染料	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 \leq 20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无	无异味	符合
5	干摩擦色牢度 酸碱色牢度 耐氯漂色牢度	GB/T3920-2008 GB/T3922-2013 GB/T7069-1997	招标要求: 干摩擦色牢度 \geq 4 酸碱色牢度 \geq 4-5 耐氯漂色牢度 \geq 4-5	4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007	招标要求: 50%棉, 50%涤 (\pm 3%)	棉: 100%	符合
7	纱线线密度 (纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 32s*32s (\pm 3%)	22S*22S	不符合

四、洗手衣 (短袖)

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	\leq 75	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.4	符合
3	可分解芳香胺染料(GB)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 \leq 20mg/kg)	未检出	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 5 页共 17 页

	18401-2010)				
4	异味	GB 18401-2010	无	无异味	符合
5	耐摩擦色牢度	GB/T3920-2008	招标要求: 干摩≥4-5 湿摩≥3-4	4-5 3-4	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007	招标要求:100%全棉精梳油绿布	棉: 100%	符合
7	纱线线密度(纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 经纱 22s, 纬纱 22s; (±3%)	22S*21.5S	符合

五、护士毛线外衣 (70毛)

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量(mg/kg)	GB/T2912.1-2009	300mg/kg	未检出	符合
2	PH值	GB/T7573-2009	4.0-9.0	5.9	符合
3	可分解芳香胺染料(GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无	无异味	符合
5	耐汗渍色牢度 耐水色牢度 耐干摩擦色牢度(级)	GB/T3922-2013 GB/T5713-2013 GB/T3920-2008	≥3	4-5	符合
6	面料成分	FZ/T01057.1~4-2007 GB/T2910.2-2009	招标要求: 15%棉, 15%聚氨酯纤维, 70%毛(±3%)	聚酯纤维: 73.0% 腈纶: 14.5% 羊毛: 12.5%	不符合
7	起毛起球(级)	GB/T4802.3-2008	≥3-4	3-4	符合

招标技术规格要求

一、护士服+实习生护士服 (女冬)

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合

二、护士服+实习生护士服 (女夏)

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T	3.8 规定	符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 6 页共 17 页

		81007-2012			
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
三、护士服+实习生护士服 (男冬)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
四、监护室护士服 (冬)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
五、监护室护士服 (夏)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
六、护士毛线外衣 (70 毛)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观疵点	FZ/T 73018-2012	4.4.6 规定	符合要求	符合
2	工艺要求:	招标要求	须植入 RFID 电子标签。	未植入 RFID 电子标签	不符合
七、成人病人服 (涤棉)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
八、儿科病人服 (纯棉)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T	3.8 规定	符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 7 页共 17 页

		81007-2012			
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	: 招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
九、监护室病人服 (涤棉)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
十、医生服 (冬)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T :2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
十一、洗手衣 (短袖)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
4	文件	招标要求	提供招标文件中“洗手衣”技术要求中1-15项检测报告	符合要求	符合
十二、拖鞋 (手术室+ICU+ccu+导管室)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	工艺要求	招标要求	须植入RFID电子标签。	符合要求	符合
4	文件	招标要求	提供招标文件中“拖鞋”技术要求中1-3项检测报告	符合要求	符合
十三、电子标签					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	文件	招标要求	提供招标文件中“拖	符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 8 页共 17 页

			鞋”技术要求中1-13项技术参数证明资料		
十四、物联管理(被服)智能信息化					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
RFID手持机技术要求:					
1	功能	招标要求	RFID手持机:手持式批量收发清点;具有盘点功能,具备自动打印功能,同时支持USB外接打印设备	已送货,未安装机器,功能未体现	-
2	硬件要求:	招标要求	1、尺寸(长×宽×厚):480×150×40mm(±3%) 2、电池:2200mAh,支持待机≥3天,持续RFID扫描≥3小时; 3、配套手持终端规格:CPU双核1.6GHz以上; 4、内存空间16GB(Flash ROM)/2GB DDR3(RAM)	已送货,未安装机器,功能未体现	-
3	软件要求	招标要求	操作系统 Android 4.0 以上	已送货,未安装机器,功能未体现	-
RFID智能工作台技术要求:					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	硬件要求:	招标要求	1、尺寸(长×宽×厚)600×500×40mm(±3%) 2、材质:ABS+金属 3、电源12V DC	已送货,未安装机器,功能未体现	-
十五、专用鞋智能信息化					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
一、系统软件					
1	功能	招标要求	a.身份识别:可以自动和医院信息化系统同步医护人员信息;可以手工建立实习生、进修生、外来厂商等人员信息; b.权限管理:可以自动和医院信息化系统同步手术上台医护人员	已送货,未安装机器,功能未体现	-

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFGJ17090099

第 9 页共 17 页

			信息, 区分医护人员可在何时进入何手术间, 提升患者隐私度; c. 出入记录: 自动识别身份, 记录出入门禁的时间等信息; d. 安全门禁: 门禁和手术排班表动态联动, 包括人工灵活调整, 实现安全门禁管理; e. 数据分析: 获取量化数据, 可进行多维分析数据挖掘;		
2	其他	招标要求	1、架构: C/S、B/S 多层架构; 2、联网: 网络中心版; 3、数据库: 微软 SQL Server; 4、接口: HIS 接口、手术排班表接口、门禁接口;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
RFID 平板桌面读写器					
1	硬件	招标要求	1. 尺寸: 380-440 (L) * 280-320 (W) * 30-35 (H) mm 2. 外壳材质: 亚克力 3. RFID 特性: 自动识别 RFID 芯片, 无须人工干预; 4. 供电方式: 12V DC 5. 接口方式: RS232/USB;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
2	通信方式	招标要求	无线;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
3	群读	招标要求	使用抗冲突算法, 同时识别多个 RFID 芯片;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
4	安装方式	招标要求	和 PC 连接。	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
RFID 地毯式天线 (手术室)					
1	硬件	招标要求	1. 尺寸: 800-900 (L) * 500-600 (W) * 20-35 (H) mm 2. 材质: 新型环保	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 10 页共 17 页

			材料 PEVA, 环保无 毒害、抗菌防静电, 减震、静音、防滑、 耐磨、可水洗; 可选 高档记忆棉珊瑚绒, 更加舒适柔软, 可擦 洗; 3. 承重 200-350Kg/M ² ; 4. RFID 特性: 自动识 别 RFID 芯片, 无须 人工干预; 4. 网络接口方式: RJ45、RS485		
2	通信方式	招标要求	无线;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
3	通信距离	招标要求	5-30CM;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
4	安装方式	招标要求	安装简洁, 直接铺设在 地面上;	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-
5	安装位置	招标要求	换鞋凳后, 缓冲区、洁 净区、手术间门前后。	已送货, 未安装机器, 功能未体现	-

*备注: “-” 不对其评价。

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099


第 11 页共 17 页

附录: 检测图片

照片 1: 护士服+
实习生护士服
(女冬)



照片 2: 护士服+
实习生护士服
(女夏)

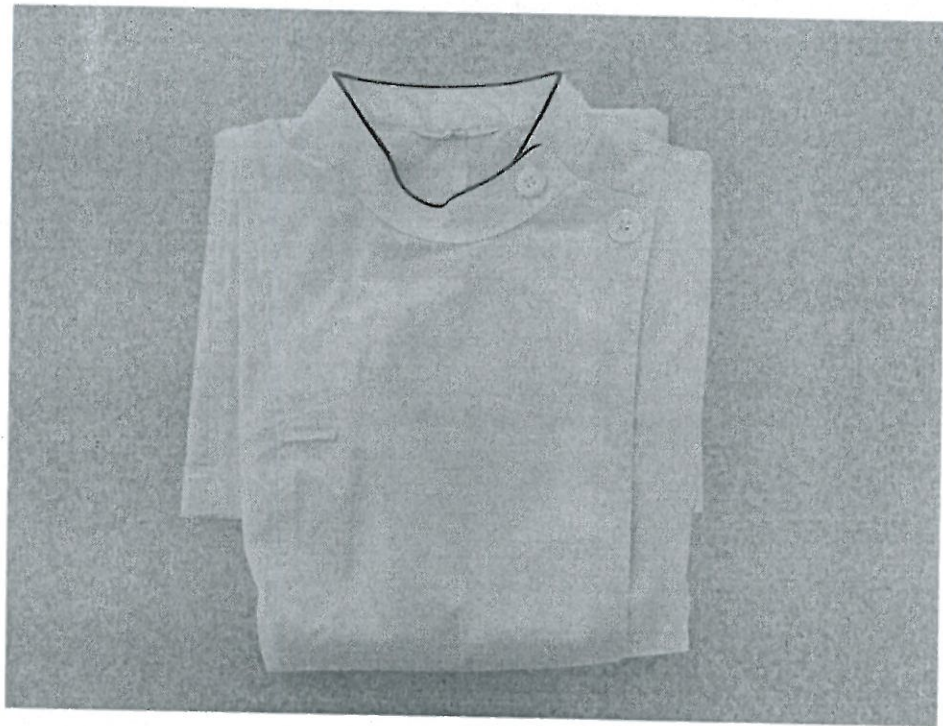


政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17090099

第 12 页共 17 页

照片 3: 护士服+
实习生护士服
(男冬)

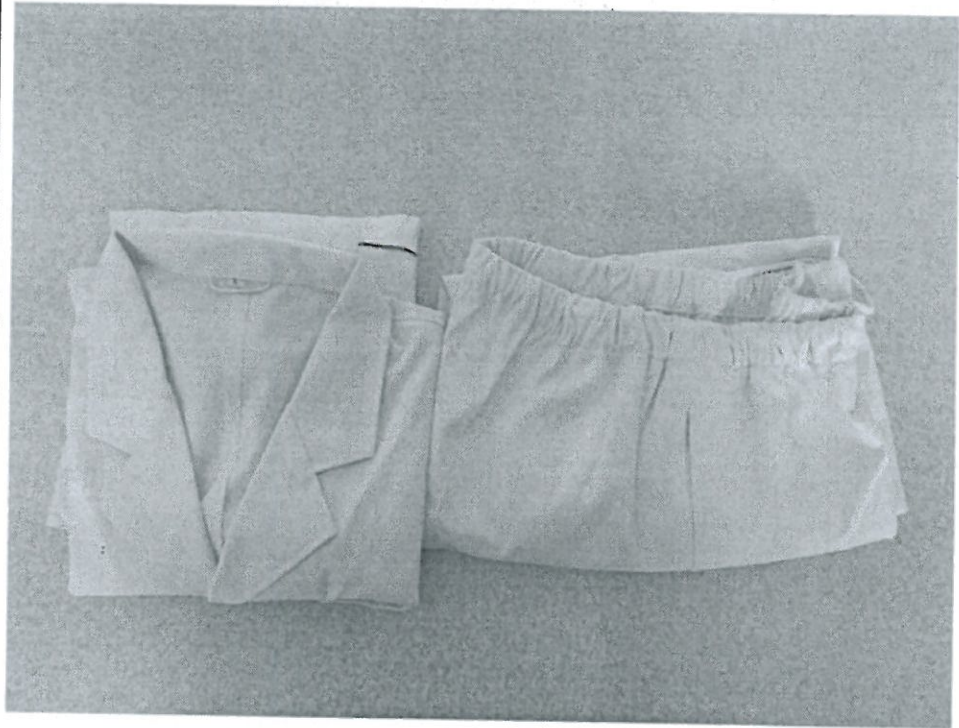

照片 4: 监护室
护士服 (冬)

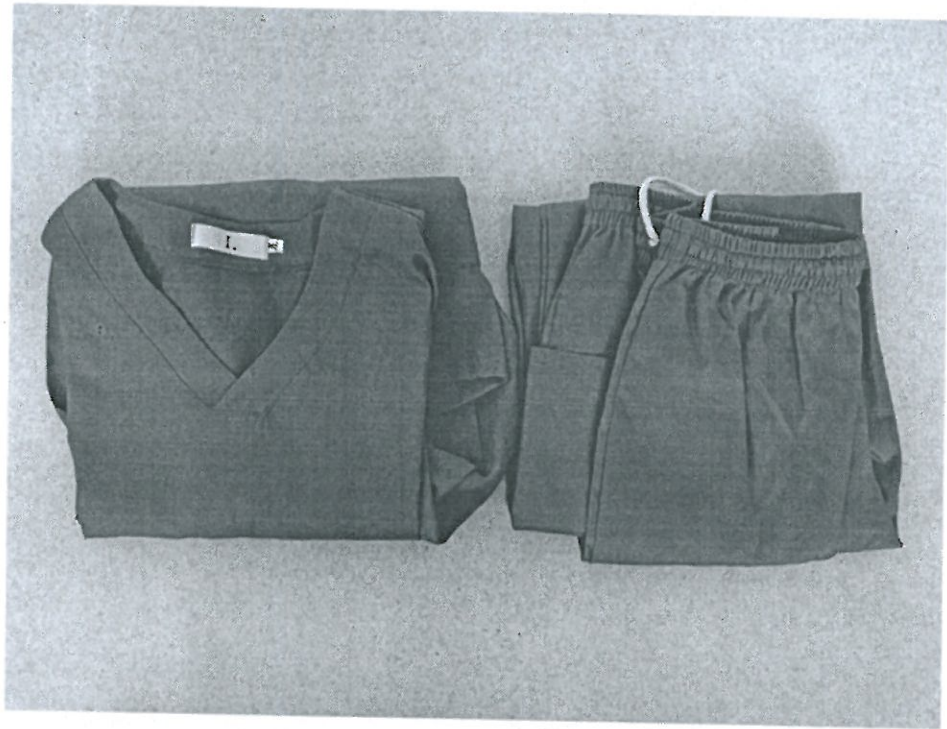

政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17090099

第 13 页共 17 页

照片 5: 监护室
护士服 (夏)



照片 6: 护士毛
线外衣 (70 毛)

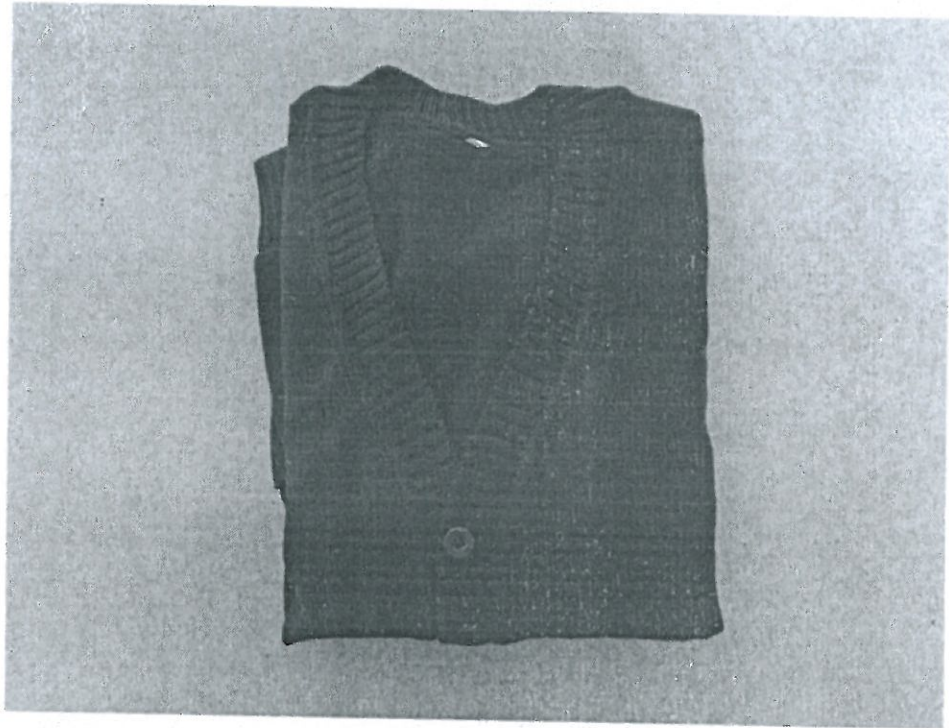


政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17090099

第 14 页共 17 页

照片 7: 成人病人服 (涤棉)

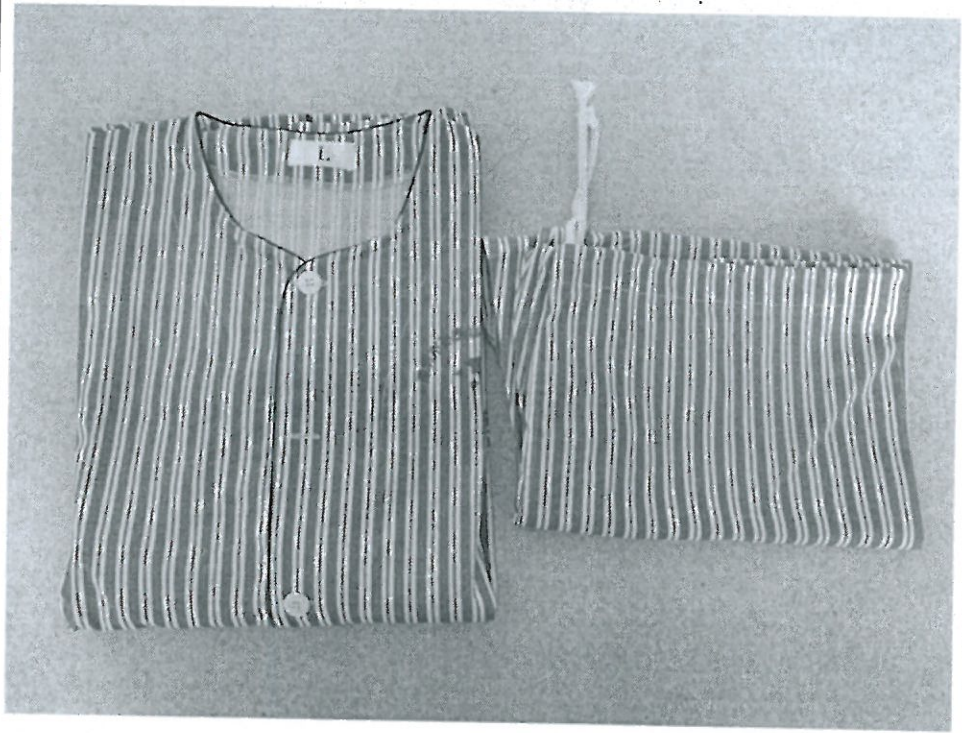

照片 8: 儿科病人服 (纯棉)

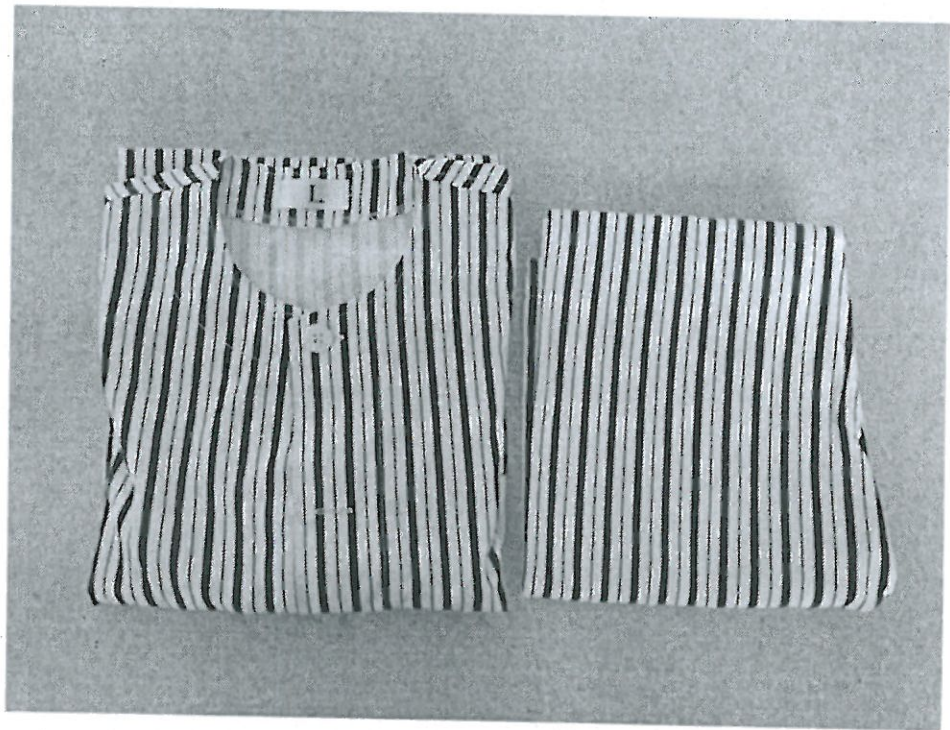

政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17090099

第 15 页共 17 页

照片 9: 监护室
病人服 (涤棉)



照片 10: 医生服
(冬)

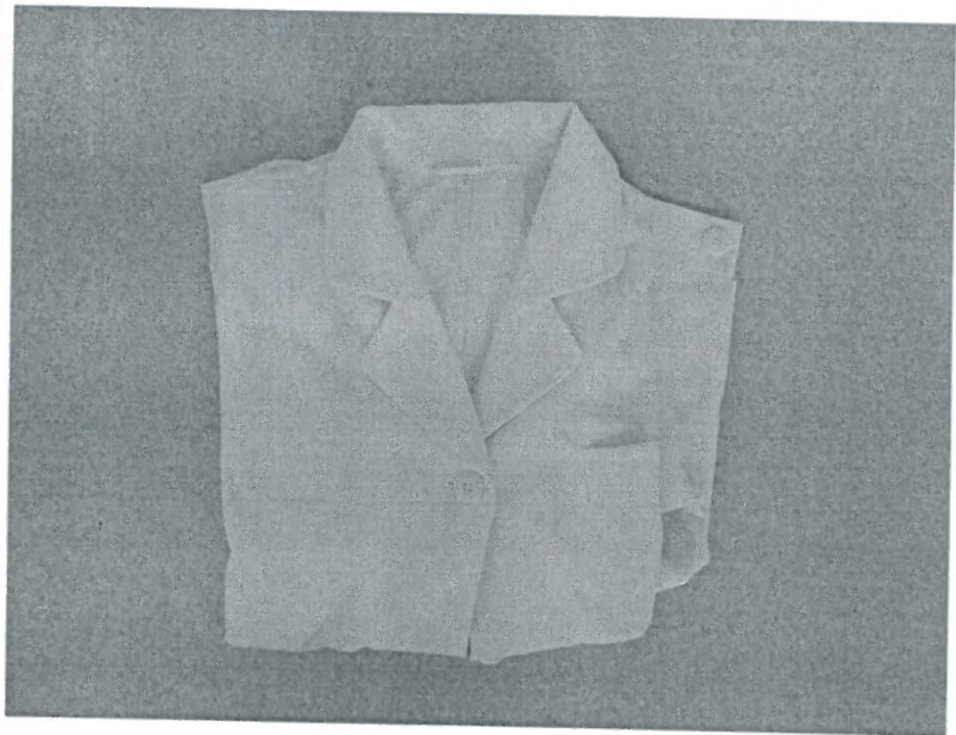

政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17090099

第 16 页共 17 页

照片 11: 洗手衣
(短袖)



照片 12: 拖鞋(手
术室+ICU+ccu+
导管室)

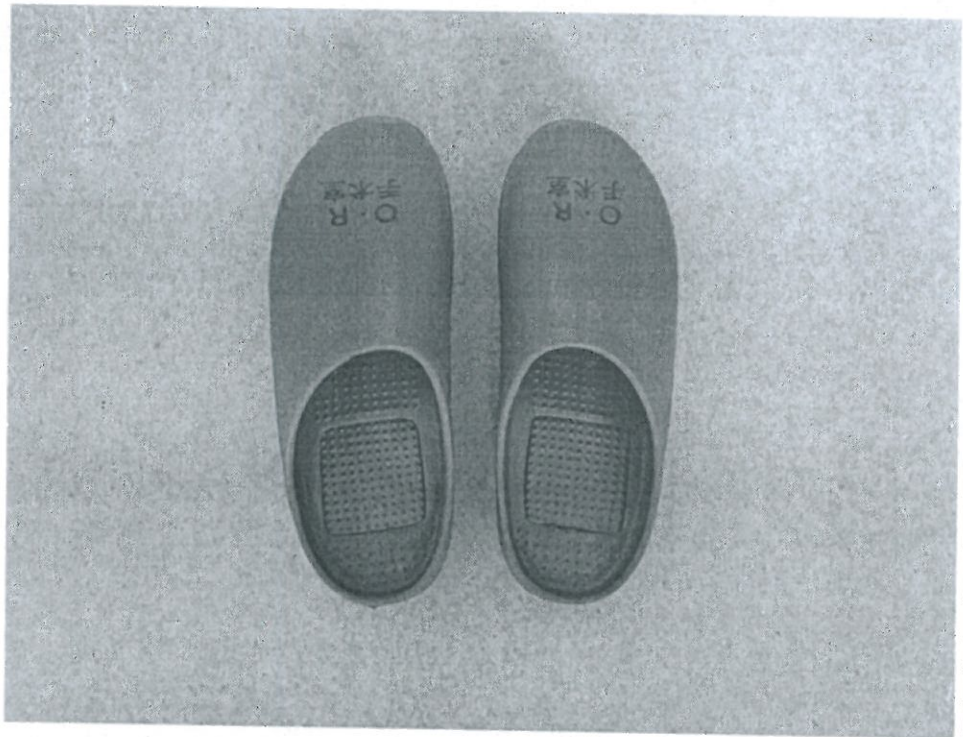

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17090099

第 17 页共 17 页

照片 13: 电子标
签

