

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI-2021-0072-01

第 1 页 共 24 页

项目名称	深圳市福田区南华实验学校校园网络改造设备采购项目		
项目编号	FTCG2020177906	合同编号	FTCG2020177906
采购人	深圳市福田区南华实验学校		
履约供应商	深圳市驰恩教学设备有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		

签发: 陈永强

陈永强

日期: 2021 年 12 月 20 日

审核: 薛晔

薛晔

日期: 2021 年 12 月 20 日

主检: 叶行华 吴昌迪

叶行华 吴昌迪

日期: 2021 年 12 月 15 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI-2021-0072-01

第 2 页 共 24 页

一、抽检总结

项目名称	深圳市福田区南华实验学校校园网络改造设备采购项目		
项目编号	FTCG2020177906	合同编号	FTCG2020177906
采购人	深圳市福田区南华实验学校		
履约供应商	深圳市驰思教学设备有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	二楼阶梯教室, 三楼信息技术中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 12 月 15 日	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市福田区南华实验学校校园网络改造设备采购项目 (项目号: FTCG2020177906) 招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市福田区南华实验学校校园网络改造设备采购项目 (项目号: FTCG2020177906) 采购合同		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对深圳市福田区南华实验学校校园网络改造设备采购项目采购项目的履约情况进行检查, 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下不符合项:</p> <p>1. 抽检方案技术条款要求中第 4 条“型号: SPC-MKUTP-C5-0”, 现场实际未能体现, 与要求不符。</p> <p>2. 抽检方案技术条款要求中第 6 条“型号: SPC-MKUTP-C3-0”, 现场实际未能体现, 与要求不符。</p> <p>3. 抽检方案技术条款要求中第 47 条“型号: TDMX-2000B2”, 现场实际发现“型号: TDMX-2000”, 与要求不符。</p> <p>4. 抽检方案技术条款要求中第 73 条“型号: LM33-45KL”, 现场实际发现“型号: LM33-60KL”, 与要求不符。</p> <p>5. 抽检方案技术条款要求中第 82 条“品牌: 深圳雷迪司”, 现场实际未能体现, 与要求不符。</p> <p>6. 抽检方案技术条款要求中第 83 条“型号: C40”, 现场实际未能体现, 与要求不符。</p> <p>7. 抽检方案技术条款要求中第 84 条“40 节容量。”, 现场实际发现“32 节容量”。</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI-2021-0072-01

第 3 页 共 24 页

与要求不符。

根据现场抽检评价,本项目履约抽检评价总分为 92.8 分,抽检结果评价等级为 良。


备注: 根据供应商在 2021 年 12 月 16 日提供资料佐证证明, 作出以下修改:

1. 抽检方案技术条款要求中第 4 条“型号: SPC-MKUTP-C5-0”, 更改为符合要求。
2. 抽检方案技术条款要求中第 6 条“型号: SPC-MKUTP-C3-0”, 更改为符合要求。
3. 抽检方案技术条款要求中第 47 条“型号: TDMX-2000B2”, 更改为符合要求。
4. 抽检方案技术条款要求中第 82 条“品牌: 深圳雷迪司”, 更改为符合要求。

根据现场抽检评价以及供应商在 2021 年 12 月 21 日提供佐证, 本项目原履约抽检评价总分为 92.8 分, 抽检结果评价等级为 良。更改为履约抽检评价总分为 96.9 分, 抽检结果评价等级为 良

具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。

抽检机构代表签字:

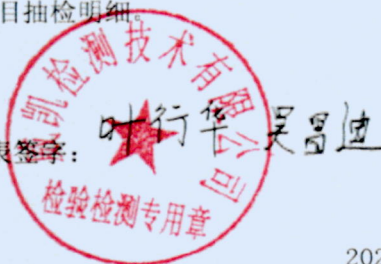

2021 年 12 月 15 日