

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 1 页 共 13 页

项目名称	大动物洗笼机等设备一批		
项目编号	SZDL2021337960	合同编号	SZHT (2021) 032741
采购人	深圳先进技术研究院		
履约供应商	广州市诚屹进出口有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		



签发日期: 2022 年 04 月 22 日


签发人: 梁志远
审核: 范国梁
主检: 谢明敏琦

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 2 页 共 13 页

一、抽检总结

项目名称	大动物洗笼机等设备一批		
项目编号	SZDL2021337960	合同编号	SZHT (2021) 032741
采购人	深圳先进技术研究院		
履约供应商	广州市诚屹进出口有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	脑解析与脑模拟平台 2 栋 A 座 11 楼洗消间	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 04 月 22 日	环境条件	— —
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 大动物洗笼机等设备一批 (项目编号: SZDL2021337960) 采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 大动物洗笼机等设备一批 (项目编号: SZDL2021337960) 招投标文件		
现场抽检 结果汇总	<p>本次依据招投标文件现场抽检《商务条款》3条,《技术条款》36条。</p> <p>经现场抽检,发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 抽检明细第 5 项,要求大动物洗笼机外形尺寸$\leq 2330 \times 2510 \times 3002$ mm,实际外形尺寸为 $2850 \times 2750 \times 3145$ mm,与要求不符。2. 抽检明细第 14 项,要求大动物洗笼机设备的前门、后门、内室均具有急停按钮装置,实际设备无后门,与要求不符。3. 抽检明细第 15 项,要求大动物洗笼机应具有前后门互锁等多种报警,实际设备无后门,与要求不符。 <p>根据现场抽检评价结果,本项目履约抽检评价总分为 92.8 分,抽检结果评价等级为良;详见后页。</p> <p>抽检机构代表签字:  明长文琦</p> <p>2022 年 04 月 22 日</p> <p>(18)</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：S2021110372180134

第 3 页 共 13 页

二、 抽检明细

商务条款						
序号	服务名称	代码	内容	分值	得分	抽检结果
1	/	b	合同签订后的四周内交货	5	5	符合要求
2	/	b	提供驻场工程师，多次现场免费培训	5	5	符合要求
3	/	b	“大型灭菌锅”属于特种设备，履约供应商应负责为采购单位办理特种设备使用登记并向采购单位交付《中华人民共和国特种设备使用登记证书》	5	5	符合要求

技术条款（采购文件技术要求）						
序号	货物名称	代码	内容	分值	得分	抽检结果
4	大动物洗笼机	b	型号：BWS-C-S9000NG 制造商名称和货物原产地：山东新华医疗器械股份有限公司、山东淄博	5	5	符合要求
5		c	外形尺寸 $\leq 2330 \times 2510 \times 3002\text{mm}$ ，内室容积 $\geq 8000\text{L}$	3	0	不符合要求
6		b	密封门：手动密封门，大面积的玻璃视窗，主动膨胀密封结构，能够实现更严格的密封	5	5	符合要求
7		b	喷淋臂：两侧水平喷淋臂+管路侧竖直喷淋臂组合	5	5	符合要求
8		b	配备椭圆管专用清洗喷嘴，舱内设置多功能接口，可以连接饮用水瓶清洗车	5	5	符合要求
9		b	自动完成包括但不限于预洗、清洗（自动注入清洗剂：酸性或碱性可自动选择）、漂洗、热水消毒、干燥等过程	5	5	符合要求

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 4 页 共 13 页

技术条款（采购文件技术要求）						
序号	货物名称	代码	内容	分值	得分	抽检结果
10		b	设备具有高于90℃的热水消毒功能,可根据需要设置不同的温度和时间,以满足不同的消毒要求。设备的显示屏上能够显示A0值	5	5	符合要求
11		b	干燥过程中,具备蒸汽加热和电加热两级加热功能,可迅速将内室温度提高到设定值,保证干燥效果	5	5	符合要求
12		b	设备配置4个水箱,酸洗、碱洗、漂洗及热力消毒、冲洗水箱分开独立设置,可最大化节约用水并降低程序时间。提供实物照片证明材料	5	5	符合要求
13		b	设备预设快速清洗程序,清洗时间≤10min	5	5	符合要求
14		b	安全性:设备有多重安全保护,设备的前门、后门、内室均具有急停按钮装置,保护人员和设备安全	5	0	不符合要求
15		b	报警提示:采取声、光报警方式,应具有前后门互锁、开关门与程序运行互锁、流程异常、非法操作、能源供应异常等多种报警,可实时显示设备的工作状态	5	0	不符合要求
16		b	过滤器自清洗:可适应实验动物笼盒废弃垫料存留多的情况,设备可自动清理过滤器	5	5	符合要求
17		b	清洗液:设备标配不少于2个加液泵,可自动添加酸性、碱性或中性清洗液,可自由设定加入量,并有清洗液不足报警功能	5	5	符合要求
18		b	控制面板:采用国际知名品牌的PLC控制清洗消毒全过程,≥9寸彩色触摸屏显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数	5	5	符合要求

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 5 页 共 13 页

技术条款（采购文件技术要求）						
序号	货物名称	代码	内容	分值	得分	抽检结果
19		b	预设3个以上清洗程序，包含：快洗程序、大动物笼具清洗程序3个固定中文程序，并有2个（含）以上自定义程序，提供程序选择界面图；具有故障自动检测和报警功能	5	5	符合要求
20		b	远程监控：预留微机监控接口，可实现远程联网监控，数据下载	5	5	符合要求
21		b	数据记录功能：带有USB接口，实现数据的长期保存	5	5	符合要求
22		b	空气过滤器：进风具有H14级或以上过滤装置，滤膜孔径 $\leq 0.22\mu\text{m}$	5	5	符合要求
23	大型灭菌锅	b	型号及规格：BIST-A-D910-B 制造商名称和货物原产地：山东新华医疗器械股份有限公司、山东淄博	5	5	符合要求
24		c	外形尺寸 $\leq 1568 \times 1744 \times 2012\text{mm}$ ，内室容积 $\geq 910\text{L}$ ；外接蒸汽源	3	3	符合要求
25		b	门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路	5	5	符合要求
26		b	设计压力： $\geq 0.3\text{Mpa}$ ，设计温度： $\geq 144^{\circ}\text{C}$	5	5	符合要求
27		b	PLC：运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议	5	5	符合要求
28		b	触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定	5	5	符合要求
29		b	屏幕尺寸：7寸；分辨率：分辨率为 800×480	5	5	符合要求

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 6 页 共 13 页


技术条款（采购文件技术要求）						
序号	货物名称	代码	内容	分值	得分	抽检结果
30		b	容量：128MFlash和256MRAM	5	5	符合要求
31		b	控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正	5	5	符合要求
32		b	管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行	5	5	符合要求
33		b	记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数	5	5	符合要求
34		b	设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃	5	5	符合要求
35		b	抽空装置：直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距	5	5	符合要求
36		b	换热装置：板式换热器	5	5	符合要求
37		b	降噪系统：带有节水降噪装置	5	5	符合要求
38		b	水回收装置：带有换热器水回收系统，节约能源	5	5	符合要求
39		b	系统管路：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理	5	5	符合要求

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 7 页 共 13 页

三、 抽检照片

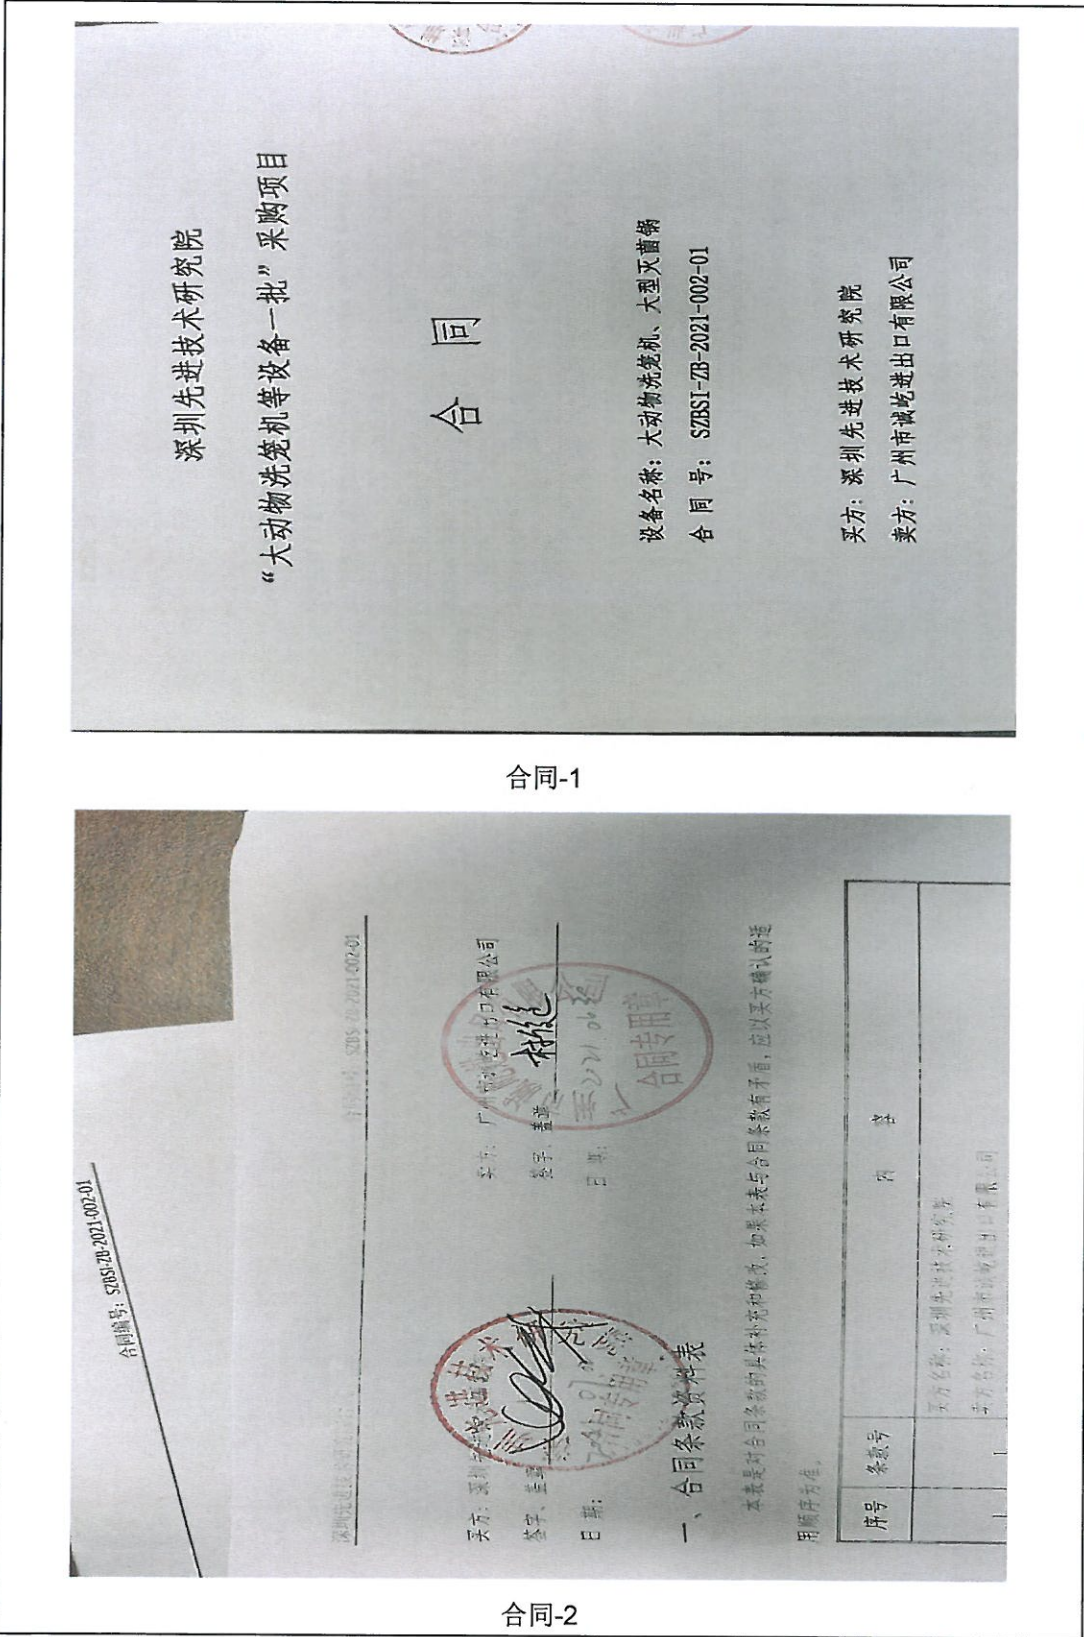

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 8 页 共 13 页

脑解析与脑模拟重大科技基础设施仪器设备使用培训记录表

组织单位: 中国科学院深圳先进技术研究院

设备名称	大动物洗笼机	规格型号	BWS-C-S9000/VG
培训主题	大动物洗笼机的操作与维护保养		
培训地点	深圳及之明科技园 脑模拟区		
培训日期	2021.8.3	培训单位	山东新华医疗器械
培训老师	高志远	联系方式	18713359508
培训方式	<input type="checkbox"/> 讲座 <input type="checkbox"/> 现场讲解示范 <input type="checkbox"/> 岗位指导 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
培训内容	1. 仪器设备的基本介绍与运行工作原理 <input checked="" type="checkbox"/> 已培训 <input type="checkbox"/> 未培训 2. 仪器设备的具体 SOP 操作流程 <input type="checkbox"/> 已培训 <input type="checkbox"/> 未培训 3. 仪器设备的日常维护与保养 <input type="checkbox"/> 已培训 <input type="checkbox"/> 未培训 4. 仪器设备常见故障的诊断与处理 <input type="checkbox"/> 已培训 <input type="checkbox"/> 未培训 5. 仪器设备的安全操作规范和使用注意事项 <input type="checkbox"/> 已培训 <input type="checkbox"/> 未培训 6. 其他 _____		

参加培训人员

序号	姓名	所属部门、中心	导师/课题组负责人
1	朱凯川	所部	朱凯川
2	杨光	脑图谱	王立平
3	陈成迪	所部	陈成迪
4	刘超	所部	王立平
5			
6			
7			
8			
9			
10			

培训记录表

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 9 页 共 13 页

2

送货单

收货单位: 深圳先进技术研究院

NO. 20210718

地址: 深圳市光明区羌下一路光明科学城项目

2021 年 7 月 18 日

型号	品名及规格	单位	数量	备注
BWS-C-S9000NG	大动物洗笼机	套	4	
BIST-A-D910-B	大型灭菌锅	套	2	

收货单位: 深圳先进技术研究院

送货单位 (盖章):

经手人签字: 张凯 2021.7.28

经手人签字: 孙春

公司: 山东新华医疗器械股份有限公司

电话: 0533-3581115

传真: 0533-3581255

地址: 山东省淄博市周村区新华大道2009号

网址:

邮箱: shitaide@shinva.com

注: 请您在收到货物后, 依订货单核对数量及型号规格, 确认后请签字回传送货单, 如在五个工作日内没有收到您的回复, 则我司视为您已签收。感谢您对我司的支持, 谢谢配合!

第一联存根(白) 第二联(蓝) 第三联回传(黄)

送货单

20210717-2

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2237039-2024

单位名称: 山东新华医疗器械股份有限公司

住所: 淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

制造地址: 1、淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
2、淄博市周村区新华大道2009号

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力容器制造(含安装、修理、改造)	固定式压力容器制造(中、低压力)	(D)	地址 1 地址 2

发证机关: 山东省市场监督管理局

发证日期: 2024年06月14日

有效期至: 2024年06月14日

5日

特种设备生产许可证


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 10 页 共 13 页



大动物洗笼机

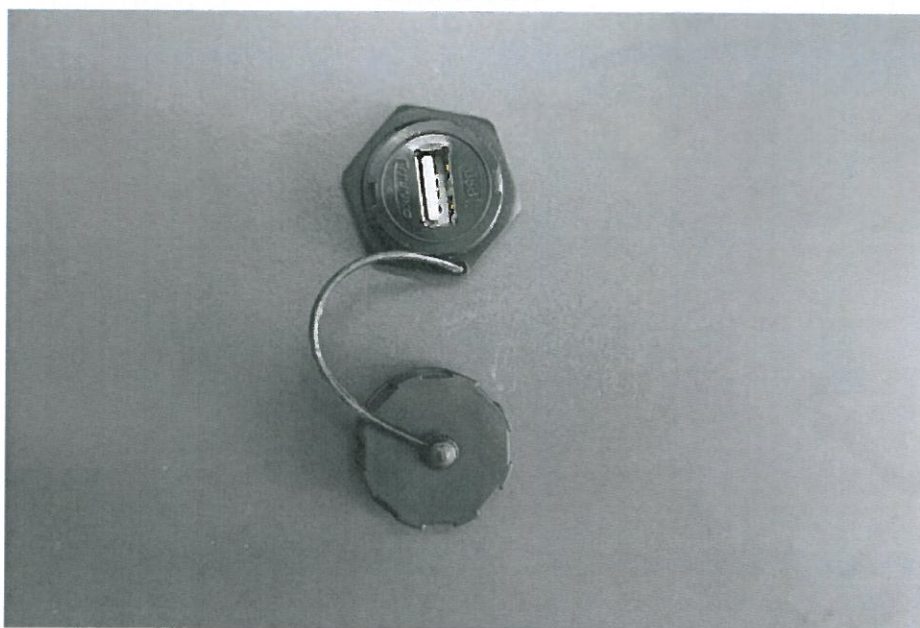

大动物洗笼机 USB 接口


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 11 页 共 13 页



大动物洗笼机急停按钮装置

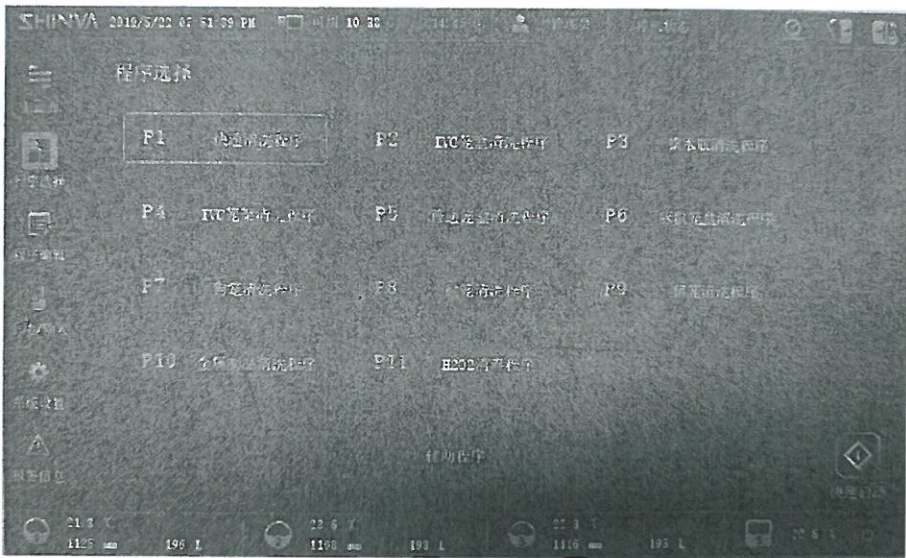

大动物洗笼机清洗程序


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 12 页 共 13 页



大型灭菌锅

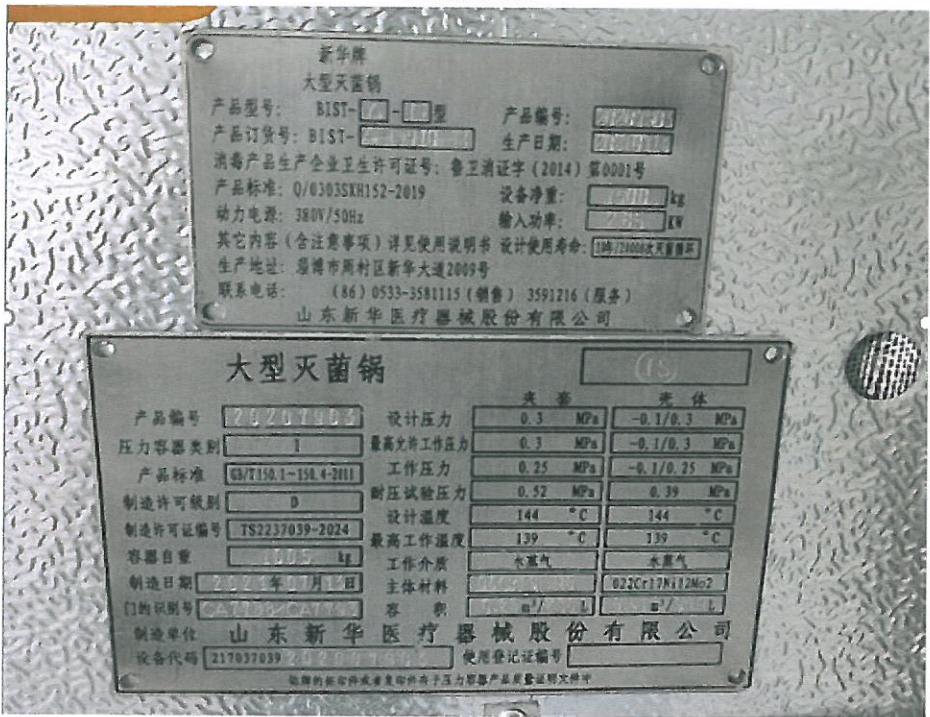


大型灭菌锅铭牌

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180134

第 13 页 共 13 页

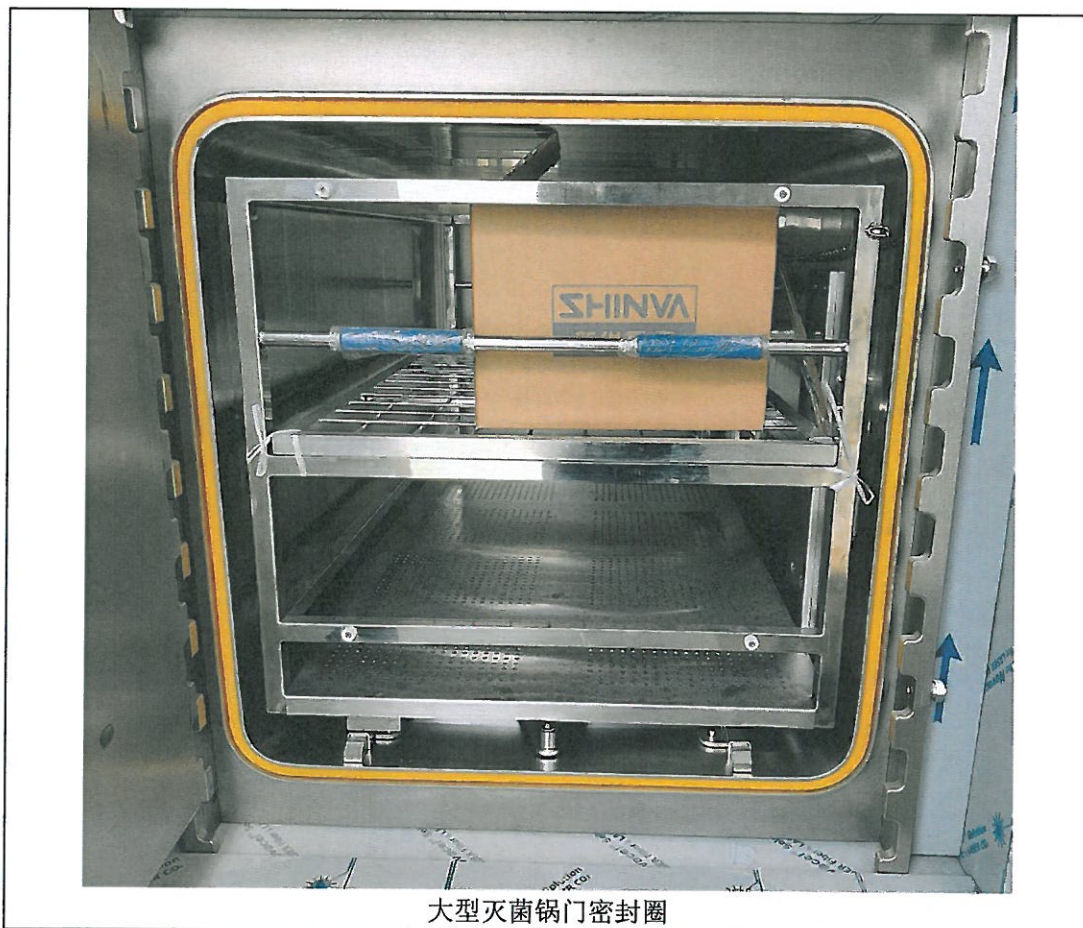

大型灭菌锅门密封圈

--报告结束--

