

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 1 页 共 14 页

项目名称	超广角激光扫描检眼镜		
项目编号	SZCG2021200530	合同编号	SZHT (2021) 033365
采购人	深圳市人民医院		
履约供应商	深圳市上示科技有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		



签发日期: 2022年05月10日

签发人: 梁志远

审核: 谢明


主检: 潘文峰 赵刚

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 2 页 共 14 页

一、抽检总结

项目名称	超广角激光扫描检眼镜		
项目编号	SZCG2021200530	合同编号	SZHT (2021) 033365
采购人	深圳市人民医院		
履约供应商	深圳市上示科技有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳市人民医院 (坂田院区) 304 眼科屈光检查室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 05 月 07 日	环境条件	—
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 超广角激光扫描检眼镜项目(项目编号: SZCG2021200530)招投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 超广角激光扫描检眼镜项目(项目编号: SZCG2021200530)采购合同		
现场抽检 结果汇总	<p>本次依据招、投标文件现场抽检《商务条款》3 条,《技术条款》33 条。</p> <p>经现场抽检,发现以下不符合项:</p> <p>1. 抽检明细第 23 项,要求要求系统电压为 200-240V,频率 50/60Hz,实际货物铭牌电压标注为 100—240V,频率 50-60Hz,与要求不符。</p> <p>本项目履约抽检评价总分为 97.6 分,抽检结果评价等级为良;详细见后页。</p> <p>抽检机构代表签字:  2022 年 05 月 07 日</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 3 页 共 14 页

二、抽检明细

商务条款						
序号	服务名称	代码	内容	分值	得分	抽检结果
1	交货要求	b	中标人在签订合同 90 天（日历日）内交货。	5	5	符合要求
2	关于验收	b	由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。	5	5	符合要求
3	付款方式	b	货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，中标人根据采购单位归口科室的通知，以银行对公转账形式向采购人提交合同金额的 5%作为履约保证金，采购单位收到后支付 100%货款。履约保证金在验收合格一年后，经采购人确认产品质量无问题后无息返还。	5	5	符合要求

技术条款						
序号	货物名称	代码	技术要求	分值	得分	抽检结果
4	超广角激光扫描检眼镜	b	激光扫描检眼镜主机型号: Daytona(P200T)	5	5	符合要求
5		b	虹膜后虚焦点超广角成像技术，非接触、一次扫描、无需拼图即可获得超广角 200°的眼底图像	5	5	符合要求
6		b	免散瞳，瞳孔直径 2mm 即可成像	5	5	符合要求
7		c	通过眼位引导，可获得 240°眼底图像	3	3	符合要求
8		b	两种拍摄功能：具备超广角彩照、超广角自发荧光两种功能	5	5	符合要求
9		c	成像模式：可自动拍摄或手动拍摄成像	3	3	符合要求
10		c	成像时间：0.4s	3	3	符合要求
11		c	利用红、绿两种激光成像分层扫描，支持疾病的监测、诊断和分层分析	3	3	符合要求
12		c	绿激光 532nm：显示视网膜神经层至 RPE 的信息，同时用作自发荧光的激发光源	3	3	符合要求

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 4 页 共 14 页

技术条款						
序号	货物名称	代码	技术要求	分值	得分	抽检结果
13		c	红激光 633nm: 显示视网膜深层 RPE 至脉络膜的信息	3	3	符合要求
14		c	图像分辨率: 14 μ m	3	3	符合要求
15		c	具备完善的读图系统	3	3	符合要求
16		c	具备分层功能, 红、绿通道可以分别显示脉络膜和视网膜	3	3	符合要求
17		b	具备 3D 立体视图演示功能, 模拟眼球立体动画, 支持白内障和屈光不正的患教演示	5	5	符合要求
18		c	具备读图放大镜视图功能, 支持图像局部放大	3	3	符合要求
19		c	测量和注释功能, 支持距离, 面积, 杯盘比测量以及标记功能	3	3	符合要求
20		c	图像可立即传输和存储, 可用于远程医疗合作	3	3	符合要求
21		c	软件具备模拟传统光学原理成像设备图像功能	3	3	符合要求
22		c	激光级别: 安全激光 1 级	3	3	符合要求
23		c	系统电压: EU/AU: 200-240V at 50/60Hz, 1.5A	3	0	不符合要求
24		c	消耗功率: 最大 500W	3	3	符合要求
25		c	激光扫描检眼镜主机 1 台	3	3	符合要求
26		c	触摸屏显示器 1 台	3	3	符合要求
27		c	电脑显示器 1 台	3	3	符合要求
28		c	电脑主机 1 台	3	3	符合要求
29		c	鼠标 1 个	3	3	符合要求
30		c	键盘 1 个	3	3	符合要求
31		c	彩色喷墨打印机 1 台	3	3	符合要求
32		c	电动升降台 1 台	3	3	符合要求
33		c	触摸屏显示器支架 1 个	3	3	符合要求
34		c	防尘罩 1 个	3	3	符合要求
35		c	面罩 1 个	3	3	符合要求

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 5 页 共 14 页

技术条款						
序号	货物名称	代码	技术要求	分值	得分	抽检结果
36		c	中文说明书 1 本	3	3	符合要求

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 6 页 共 14 页

三、抽检照片

深圳市人民医院医疗设备采购合同

医疗设备购销合同

设备(项目)名称: 超广角激光扫描性眼镜
招标编号: S2CG2021200530

甲方(买方): 深圳市人民医院
乙方(卖方): 深圳市社科投有限公司

甲(买方)、乙(卖方)双方根据中华人民共和国合同法相关规定,在平等互利,协商一致的基础上,双方同意签订本合同。

一、设备名称、型号规格、基本配置、单位、数量、单价及总金额:

序号	设备名称	产地/品牌	型号规格	单位	数量	单价(万元)	金额(万元)
1.	超广角激光扫描性眼镜	英国/欧堡	Daytona (p100T)	套	1	149.8	149.8
2.							
3.							
4.							
5.							

合计: 1台(套), 金额合计: 149.8万元(大写: 壹佰肆拾玖万捌仟肆元整)

备注: 设备基本配置及相关技术参数详见投标书。

二、设备的交付期:

1. 乙方在合同签订后的 90 天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。

三、设备运输、安装和验收

3.1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。不易搬动或不宜在库房保存的设备,到货后直接交使用科室/部门接收保管。

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在 7 天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后,乙方应在接到甲方通知后 7 天内安装调试完成。如乙方在设备到货后一周内未进行安装调试,或安装调试时间超过正常要求,按每超过一天罚款合同总金额的 0.5%或按实际损失罚款。情节严重者,甲方将依法程序对乙方进行索赔。

3.4 由设备生产厂家代表、中标人(乙方)代表、甲方使用科室及设备科工程师共同进行设备/材料的验收。验收标准按照国家规定标准执行。

四、付款方式:

1

采购合同

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 7 页 共 14 页

中国建设银行网上银行电子回单				
币别: 人民币元		日期: 20211109	凭证号: 103903673340	
		账户明细编号-交易流水号: 3824-4420000660N3P4AQC5A		
付款人	全称	深圳市上示科技有限公司	收款人	
	账号	44201581500052529395	全称	深圳市人民医院
	开户行	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	账号	41001900040000093
大写金额	柒万肆仟玖佰元整		小写金额	74,900.00
用途	超广角激光扫描检测眼镜5%质保金		钞汇标志	钞
摘要	自定义			
重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。				

保证金凭证

中国建设银行网上银行电子回单				
币别: 人民币元		日期: 20211130	凭证号: 3886-4420000000N3P4AQC5A	
		账户明细编号-交易流水号: 3886-4420000000N3P4AQC5A		
付款人	全称	深圳市财政局	收款人	
	账号	41000500040030123	全称	深圳市上示科技有限公司
	开户行	中国农业银行深圳市分行	账号	44201581500052529395
大写金额	壹佰肆拾玖万捌仟元整		小写金额	1,498,000.00
用途	九轴干涉仪扫描仪百分之百设备款		钞汇标志	钞
摘要	自定义			
重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。				

中国建设银行网上银行电子回单				
币别: 人民币元		日期: 20211130	凭证号: 3887-4420000000N3P4AQC5A	
		账户明细编号-交易流水号: 3887-4420000000N3P4AQC5A		
付款人	全称	深圳市财政局	收款人	
	账号	41000500040030123	全称	深圳市上示科技有限公司
	开户行	中国农业银行深圳市分行	账号	44201581500052529395
大写金额	壹佰肆拾玖万捌仟元整		小写金额	1,498,000.00
用途	超广角激光扫描检测眼镜百分之百设备		钞汇标志	钞
摘要	自定义			
重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。				

全款付款凭证

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 8 页 共 14 页

仪器设备安装验收报告

仪器设备所在科室: 深圳市人民医院 (坂田眼科)	
仪器设备名称: 超广角激光扫描检眼镜	
生产日期: 2021.4.22	序列号: 22319
规格型号: Daytona (P200T)	设备规格: (有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>)
品牌: 欧堡	数量: 1套
单价: 149.8万元	合同编号: SZ032021200530
总价: 149.8万元	注册证号: 国械注进20183162530
是否进口设备: (是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>)	
设备到货时间: 2021年10月20日	
开箱检验设备: 外观完好 <input checked="" type="checkbox"/>	外观破损 <input type="checkbox"/>
按合同核对配置及数量 (附配置清单): 符合合同要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合合同要求 <input type="checkbox"/>	
核对人 (使用科室): 吴晓德 杨倩	日期: 2021年10月20日
核对人 (设备部门): 杨倩	
开机设备运行情况: 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>	
设备培训: <input checked="" type="checkbox"/> 仔细阅读使用说明书 <input checked="" type="checkbox"/> 由厂家或院工程师现场培训操作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 操作人员熟悉操作规范 <input checked="" type="checkbox"/> 详细了解设备运行状况 <input checked="" type="checkbox"/> 操作人员可以独立正常操作该设备 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 无	

验收报告-1

仪器设备安装验收报告


仪器设备所在科室: 深圳市人民医院 (坂田眼科)	
仪器设备名称: 超广角激光扫描检眼镜	
生产日期: 2021.4.22	序列号: 22319
规格型号: Daytona (P200T)	设备规格: (有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>)
品牌: 欧堡	数量: 1套
单价: 149.8万元	合同编号: SZ032021200530
总价: 149.8万元	注册证号: 国械注进20183162530
是否进口设备: (是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>)	
设备到货时间: 2021年10月20日	
开箱检验设备: 外观完好 <input checked="" type="checkbox"/>	外观破损 <input type="checkbox"/>
按合同核对配置及数量 (附配置清单): 符合合同要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合合同要求 <input type="checkbox"/>	
核对人 (使用科室): 吴晓德 杨倩	日期: 2021年10月20日
核对人 (设备部门): 杨倩	
开机设备运行情况: 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>	
设备培训: <input checked="" type="checkbox"/> 仔细阅读使用说明书 <input checked="" type="checkbox"/> 由厂家或院工程师现场培训操作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 操作人员熟悉操作规范 <input checked="" type="checkbox"/> 详细了解设备运行状况 <input checked="" type="checkbox"/> 操作人员可以独立正常操作该设备 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 无	

验收报告-2

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 9 页 共 14 页



超广角激光扫描检眼镜

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 10 页 共 14 页




设备铭牌


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 11 页 共 14 页

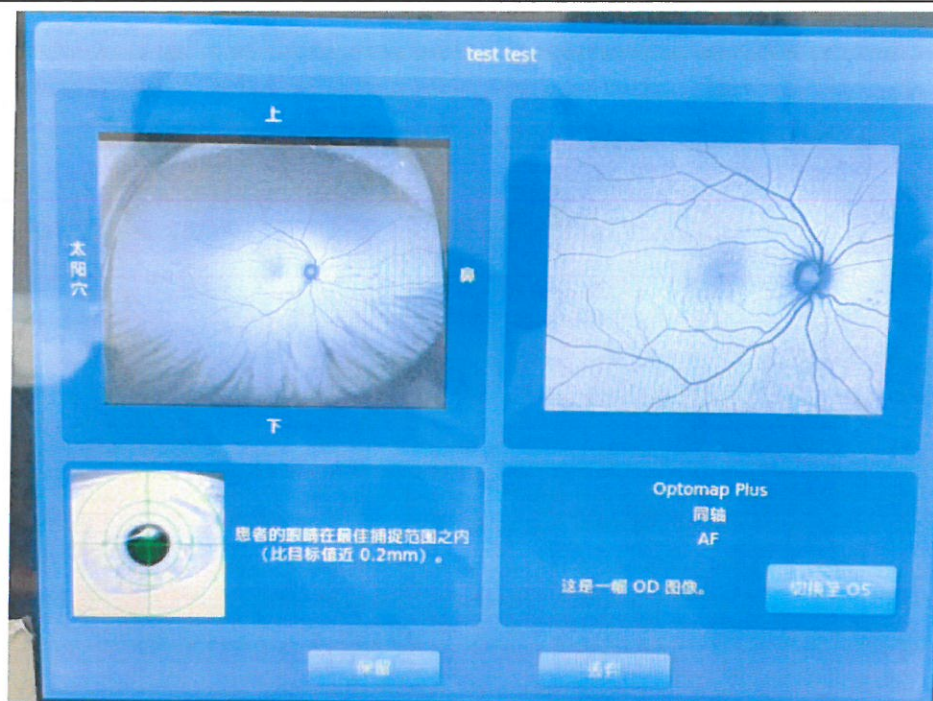

超广角自发荧光拍摄

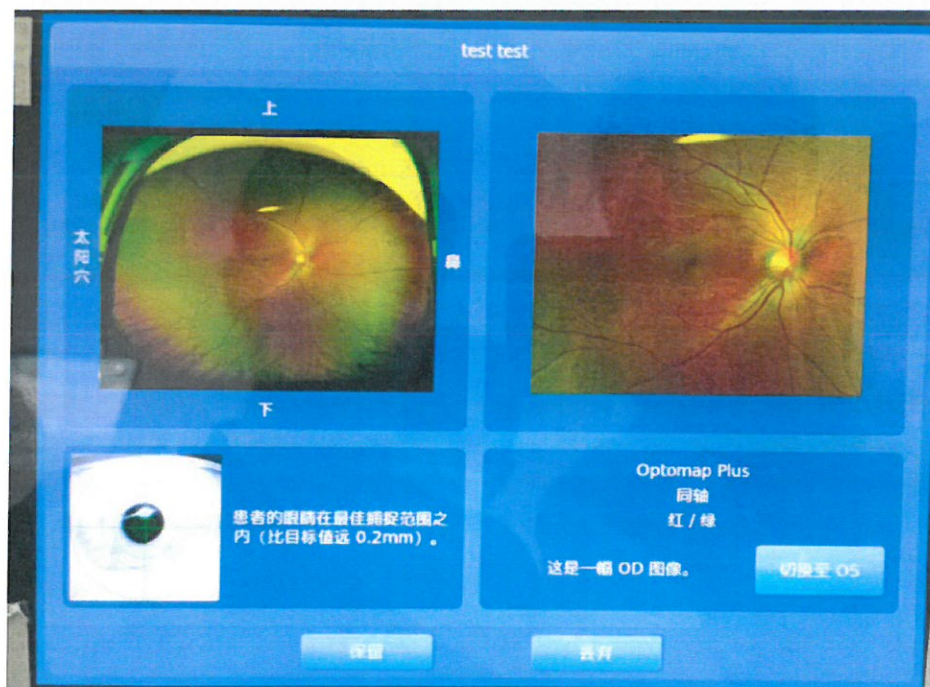


超广角彩照


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 12 页 共 14 页

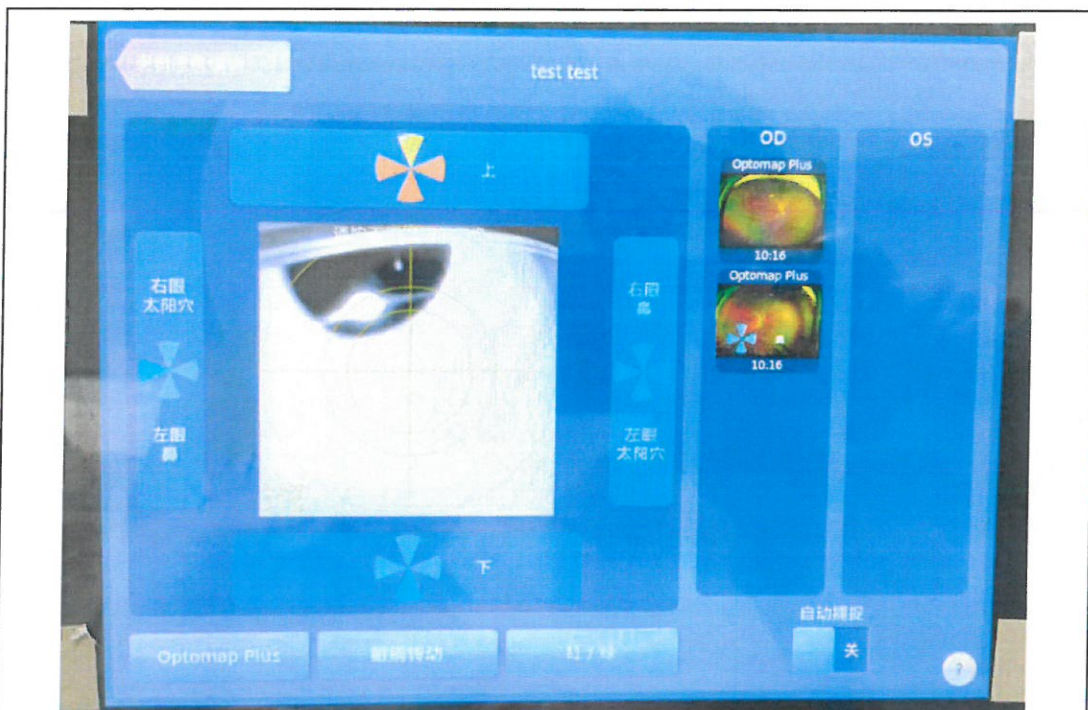

眼位引导

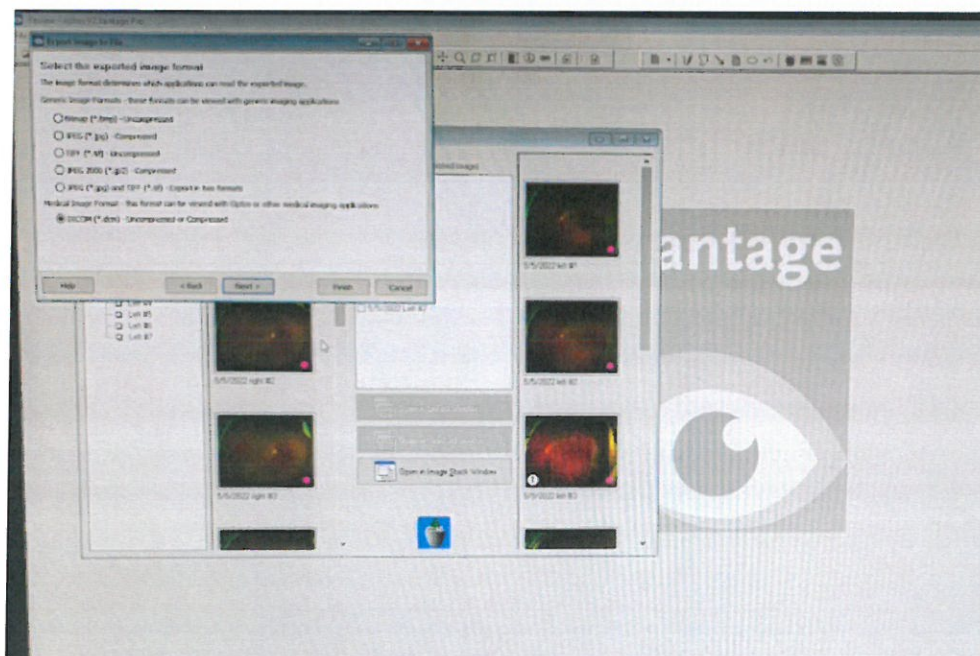


传输和存储功能

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139


第 13 页 共 14 页



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180139

第 14 页 共 14 页



显示脉络膜和视网膜

--报告结束--