

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0063


第 1 页 共 11 页

项目名称	电子鼻咽喉镜		
项目编号	SZCG2021199271	合同编号	SZHT（2021）033338
采购人	深圳市儿童医院		
履约供应商	深圳市和成医疗设备有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		

签发：陈永强

审核：肖雄

主检：罗彬 江永权







日期：2022 年 6 月 20 日

日期：2022 年 6 月 20 日



日期：2022 年 6 月 17 日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0063

第 2 页 共 11 页

一、抽检总结

项目名称	电子鼻咽喉镜		
项目编号	SZCG2021199271	合同编号	SZHT (2021) 033338
采购人	深圳市儿童医院		
履约供应商	深圳市和成医疗设备有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	耳鼻喉科-内镜室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 6 月 17 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 电子鼻咽喉镜（项目编号：SZCG2021199271）招投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 电子鼻咽喉镜（项目编号：SZCG2021199271）采购合同		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对电子鼻咽喉镜采购项目的履约情况进行检查，分项条款共 47 项，经抽检，未发现不符合项。</p> <p>根据现场抽检评价，本项目履约抽检评价总分为 100 分，抽检结果评价等级为优。具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p>抽检机构代表签字： </p> <p>2022 年 6 月 17 日</p>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0063

第 3 页 共 11 页

二、抽检明细

商务条款					
序号	抽检项	代码	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货要求	b	在签订合同之日起 60 天内交货	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2		b	提供的货物为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告，提供扫描件，原件备查。其中，进口设备具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	验收	b	产品运至采购方指定地点后，采购方的验收小组按合同中规定的产品的品种、型号、规格、数量、质量进行验收，并签署验收证明	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	培训	b	派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
5	超高清电子影像处理机（摄像系统冷光源一体机）	b	产品采用全新高清视频倍线技术实现高清图像，分辨率 1920x1080	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6		b	产品采用红、绿、蓝全光谱，可实现特殊图像显示，没有缺色现象，画面真实、准确，红光辐波长（630nm-660nm）、绿光辐波长（515nm-545nm）、蓝光辐波长（435nm-465nm）	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7		b	产品具有 i-scan 智能光染色功能，可进行早癌筛查	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0063

第 4 页 共 11 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
8		b	产品具有 SE 表面增强功能，可清晰显示黏膜的细微凹凸变化；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9		b	具有 CE 对比增强功能，可清晰显示病变的微细结构和边界，具有色调增强功能、轮廓增强功能、色彩平衡调节功能	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10		b	产品具有白平衡 2 任务模式，可使用鼻咽喉镜任一遥控按键激活	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
11		b	产品主机内置冷光源，主灯为氙灯，备用灯为 LED 灯	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
12	高清电子鼻咽喉镜	b	先端部外径：2.4mm	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
13		b	插入部外径：2.9mm	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
14		b	有效长度 300mm	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
15		b	电子鼻咽喉镜配合摄像系统可实现防抖功能，可自动存储画质最佳图像	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
16		b	镜子连接摄像系统位置的缆线可 180 度旋转，使用镜子时方便移动，有效保护镜子，减少损坏	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
17		b	产品的导光缆分布采用长条形设计，放大光源分布面积，提高周围亮度	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18		b	产品的插入部采用逐渐变细的锥形设计，便于插入，提高操作性	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
19		b	产品可全浸泡清洗消毒和低温等离子灭菌	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
20	高清医用	b	屏幕尺寸 24 英寸	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0063

第 5 页 共 11 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
21	监视器	b	分辨率 1920×1080，长宽比 16：9。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
22		b	具备多种接口：DVI-D、复合模拟、Y/C、RGB 等	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
23	台车	b	台车与电子鼻咽喉镜同一品牌，配安放支架，放置镜子安全、可靠，不易滑落	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
24		b	多层设计，可放置电刀及视频打印机等	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
25		b	提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
26	配置清单	b	超高清电子影像处理机(摄像系统冷光源一体机)：1 台	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
27		b	高清电子鼻咽喉镜：1 条	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
28		b	高清医用显示器：1 台	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
29		b	医用台车：1 台	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
30		b	键盘：1 个	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
31		b	白平衡帽：1 个	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
32		b	BNC-BNC 线：1 条	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
33		b	Y/C 线：1 条	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
34		b	RGB 线：1 条	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
35		b	控制线：2 条	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
36		b	DVI 线：1 条	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0063

第 6 页 共 11 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价
37		b	HD-SDI 线：1 条	符合要求	符合☑ 不符合□
38		b	电源线：1 条	符合要求	符合☑ 不符合□
39		b	水瓶：1 个	符合要求	符合☑ 不符合□
40		b	浸泡防护帽：1 个	符合要求	符合☑ 不符合□
41		b	通风帽：1 个	符合要求	符合☑ 不符合□
42		b	测漏器：1 个	符合要求	符合☑ 不符合□
43		b	单门内镜储存柜：1 个	符合要求	符合☑ 不符合□
44		b	台式电脑：1 台	符合要求	符合☑ 不符合□
45		b	打印机：1 台	符合要求	符合☑ 不符合□
46		b	灯泡：1 个	符合要求	符合☑ 不符合□
47		b	硬式内镜：20 根	符合要求	符合☑ 不符合□
注：1. 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示；					
评价分：100 分					
评价等级：☑优 □良 □中 □差					

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0063

第 7 页 共 11 页

三、抽检照片



项目合同

验收报告


培训记录

送货单


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0063

第 8 页 共 11 页

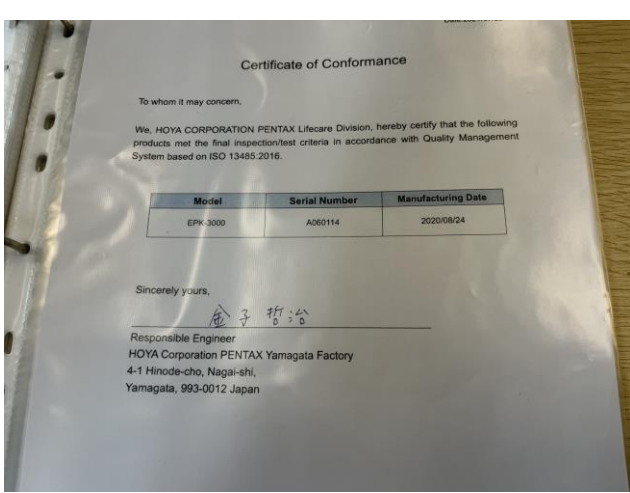

原产地证明和检验检疫证明文件

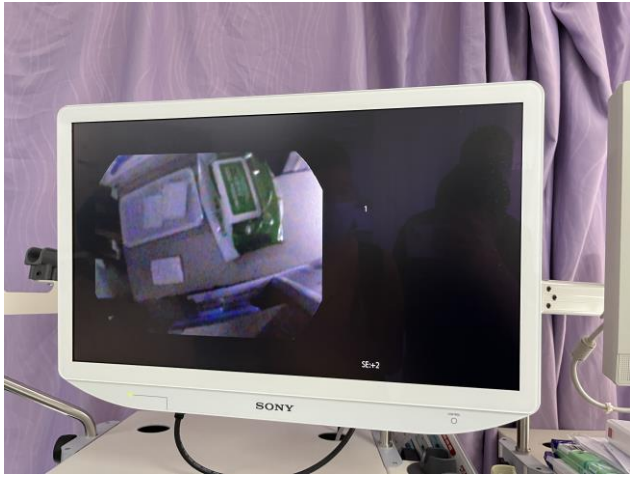

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0063

第 9 页 共 11 页



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0063

第 10 页 共 11 页



超高清电子影像处理机



单门内镜储存柜

硬式内镜



打印机

测漏器

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0063

第 11 页 共 11 页



以下空白