


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0062

第 1 页 共 6 页

项目名称	全自动过敏原检测仪		
项目编号	SZCG2021199272	合同编号	SZHT (2021) 034189
采购人	深圳市儿童医院		
履约供应商	深圳无限智库科技有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		

签发：陈永强




日期：2022 年 6 月 22 日

审核：肖雄



日期：2022 年 6 月 22 日

主检：张伸正 曹其春





日期：2022 年 6 月 17 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0062

第 2 页 共 6 页

一、抽检总结

项目名称	全自动过敏原检测仪		
项目编号	SZCG2021199272	合同编号	SZHT (2021) 034189
采购人	深圳市儿童医院		
履约供应商	深圳无限智库科技有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳市儿童医院检验科免疫功能室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 6 月 17 日	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 全自动过敏原检测仪项目（项目编号: SZCG2021199272）招投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 全自动过敏原检测仪项目（项目编号: SZCG2021199272）采购合同		
现场抽检结论	<p>本次现场抽检是对全自动过敏原检测仪项目的履约情况进行检查，分项条款共 13 项，经抽检，发现以下不符合项：</p> <p>1、抽检方案商务条款第 4 条要求“产品出厂日期与合同签订日相距不得超过 2 年”，实际合同签订时间为 2021 年 9 月 30 日，产品生产日期为 2018 年 10 月 26 日，与要求不符。</p> <p>2、抽检方案技术条款第 7 条要求“sIgE 测量范围为 0.1-100KUA/L”，实际 sIgE 测量范围为 0.001-100KUA/L，与要求不符。</p> <p>3、抽检方案技术条款第 10 条要求“检测通量 200 测试/小时”，实际检测通量 240 测试/小时，与要求不符。</p> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 76.9 分，抽检结果评价等级为中。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <div>抽检机构代表签字： </div> <div>2022 年 6 月 17 日</div>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0062

第 3 页 共 6 页

二、抽检明细

商务条款					
序号	抽检项	代码	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货要求	b	签订合同后 45 天内交货并且完成安装	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2		b	履约供应商应提供货物的技术文件,包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册(含维修密码及接口数据)、质量保证文件、服务指南等,所有外文资料须提供中文译文	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	售后服务	b	合同交付的产品质量应该符合国家规定和合同约定标准的合格产品,并与投标时承诺的质量相一致	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4		b	产品出厂日期与合同签订日相距不得超过 2 年	合同签订时间为 2021 年 9 月 30 日,产品生产日期为 2018 年 10 月 26 日,与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
5	培训	b	履约供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导,直至其完全掌握设备的基本故障处理技术	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
6	全自动过敏原检测仪	b	设备采用荧光免疫法全定量检测,可同时检测特异性 IgE(sIgE)和总 IgE	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7		b	sIgE 测量范围为 0.1-100KUA/L	实际 sIgE 测量范围为 0.001-100KUA/L,与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
8		b	总 IgE 测量范围为 2-5000KU/L	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9		b	设备可检测过敏原种类多于 30 种,并可以根据临床需求进行混合或者单项的自由组合	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0062

第 4 页 共 6 页

技术条款					
序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
10		b	血清用量为 40u1/测试, 检测通量 200 测试/小时	实际检测通量 240 测试/小时, 与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
11		b	设备采用六点定标, 一次定标 28 天有效, 减少成本, 定标品可溯源至 WHO 参考标准	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
12		b	配置清单 1. 全自动过敏原检测仪: 1 台	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
13		b	2. 配套电脑及分析软件: 1 套	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注: 1. 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示;					
评价分: 76.9 分					
评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: GPI2022-0062

第 5 页 共 6 页

三、抽检照片



合同

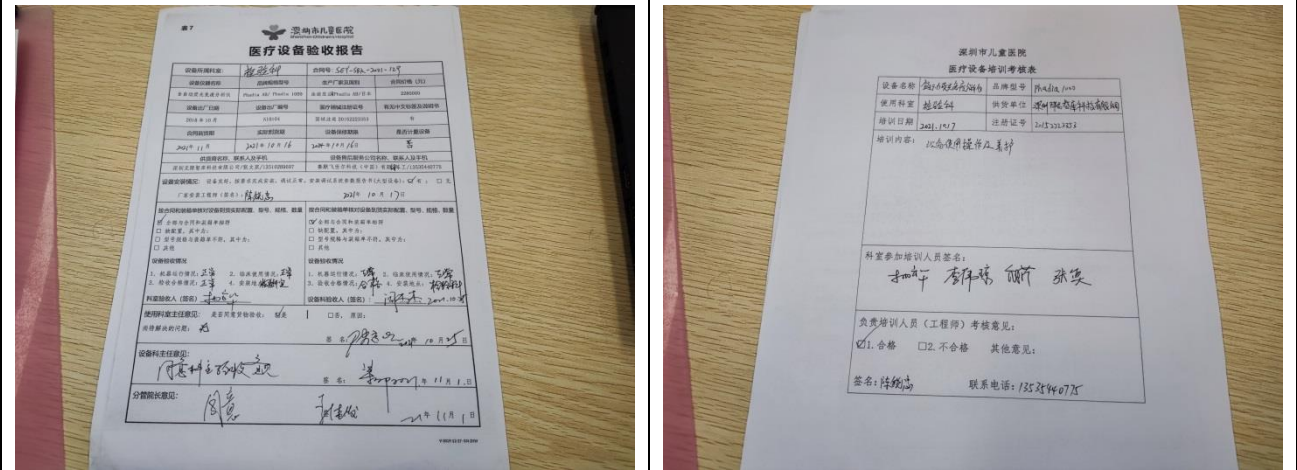

验收报告

培训记录



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0062

第 6 页 共 6 页



全自动过敏原检测仪

— 以 下 空 白 —